



临夏县人民医院医疗设备采购项目

招 标 文 件

货物类

招标编号：LXZC113202501890009

采 购 人：临夏县人民医院

招标机构：甘肃合岳工程项目管理有限责任公司

二〇二五年六月





目录

第一章、投标邀请函4

第二章、投标人须知8

 投标须知前附表 8

 2.1 总 则 16

 2.2 招标文件 20

 2.3 投标文件 21

 2.4 开标和评标 24

 2.5 废标和串通投标27

 2.6 中标通知书 27

 2.7 合同签订及履行27

 2.8 其他规定 29

第三章、询问和质疑30

第四章、采购项目需求 32

 4.1 设备名称和数量32

 4.2 交付要求： 32

 4.3 履约保证金 66

 4.4 售前服务要求66

 4.5 售后服务 66

第五章、评标原则及办法 67

 5.1 评标工作中的原则及组织 67

 5.2 评标程序 67

 5.3 评标方法 69

 5.5 中标供应商的确定96

第六章、电子投标文件格式 97

 资格证明文件 98

 附件 1:采购合同格式100

 附件 2 105

 投标函 105

 附件 3 106

 法定代表人身份证明 106

 附件 4 107

 法人授权函 107



附件 5108

投标报价明细表108

附件 6109

投标人基本情况109

附件 7110

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表110

附件 8111

产品质量保证与服务承诺函111

附件 9112

近三年已完成类似项目一览表112

附件 10113

投标货物偏离表113

附件 11114

没有重大违法记录的书面声明书114

附件 12115

投标单位承诺书115

附件 13:116

同意招标文件条款声明116

附件 14:117

虚假应标承担责任声明117

附件 15118

联合体协议（如有）118

附件 16119

政府采购政策情况表119

残疾人福利性单位声明函（投标人）122

残疾人福利性单位声明函（制造商）123

政府采购促进中小企业发展管理办法 财库（2020）46 号124

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知130

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知131

附件 17133

“网上开标系统”投标供应商用户手册133



第一章、投标邀请函

甘肃合岳工程项目管理有限责任公司受临夏县人民医院的委托,对临夏县人民医院医疗设备采购项目进行公开招标, 欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号: LXZC11320250189

二、招标内容:

包号	货物名称	主要技术参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	宫腔镜（进口产品已论证）	详见采购需求	套	1	制造业或批发和零售业
2	手术显微镜（进口产品已论证）	详见采购需求	套	1	制造业或批发和零售业
3	心电生理网络系统	详见采购需求	套	1	制造业或批发和零售业
4	体外冲击波治疗仪	详见采购需求	套	2	制造业或批发和零售业
5	冲击波治疗仪	详见采购需求	套	1	制造业或批发和零售业
6	高频手术设备	详见采购需求	套	1	制造业或批发和零售业
7	可视喉镜	详见采购需求	套	3	制造业或批发和零售业
8	血管内超声诊断仪	详见采购需求	套	1	制造业或批发和零售业
9	低速冷冻离心机	详见采购需求	套	1	制造业或批发和零售业

三、项目预算: 752 万元（第一包: 145 万元; 第二包: 135 万元; 第三包: 75 万元; 第四包: 100 万元; 第五包: 82 万元; 第六包: 60 万元; 第七包: 45 万元; 第八包: 50 万元; 第九包: 60 万元）

四、预留采购份额: 本项目预留方式为设置专门采购包, 其中第四、五、六、七、八、九包为专门面向中小企业采购, 预留金额为 397 万元, 预留比例为 52.8%。

五、投标人资格要求:

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;



2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标

3、本项目的特定资格要求：供应商必须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（**原件彩色扫描件加盖本单位公章**）

4、投标人须为在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。（适用于第四、五、六、七、八、九包）

六、招标文件获取方式：

1、社会公众可通过临夏州公共资源交易网（网址：<http://47.114.12.178>）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与临夏州公共资源交易活动的潜在投标人需先在在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或 CA 数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。

2、获取时间：2025 年 6 月 13 日 00 时 00 分至 2025 年 6 月 19 日 23 时 59 分 59 秒（北京时间，节假日不休息）

3、网上我要投标的截止时间为招标文件规定的截止时间,逾期下载招标文件的投标人，视为无效投标人。（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）

4、潜在投标人自确认参加投标至投标截止时间前应随时登陆《临夏州公共资源交易网》关注该项目招标人（招标代理）发出的通知、变更、答疑等内容。

5、下载的招标文件须安装最新版甘肃中工投标文件编制工具后打开。

七、投标截止时间及方式：

1、提交投标文件截止时间：2025 年 7 月 3 日上午 9 时 20 分。（北京时间）

2、投标文件递交方式：网络递交投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至临夏州公共资源交易电子服务系统（网址：<http://47.114.12.178>），逾期未上传到指定的网络开标系统的投



标文件，招标人不予受理。

3、开标地点：临夏州公共资源交易中心五楼电子开标厅（不见面开标）

4、注意：

（1）本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。

（2）投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。

（3）本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），并进入参与项目等待开标。

（4）本项目解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。

（5）开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的 CA 锁完成投标文件解密等操作。

5、开标结束后五个工作日内，投标单位须做 1 份纸质版投标文件签字盖章报送至代理机构。

八、开标时间、地点及方式：

1、开标时间：2025 年 7 月 3 日 9 时 20 分。（北京时间）

2、开标地点：临夏州公共资源交易中心电子开标厅

3、开标方式：甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）。

九、公告期限：自本公告发布之日起五个工作日

十、联系方式：

采购人：临夏县人民医院

联系人：乔国海

联系电话：13993038037

单位地址：甘肃省临夏县双城新区



代理机构：甘肃合岳工程项目管理有限责任公司

联系人：王盼发

联系电话：15293035476

单位地址：甘肃省临夏州临夏市红园街道西城壕路 33 号商铺

监管单位：临夏县财政局政府采购办公室

联系电话：0930-6668070

单位地址：临夏县榆丰路兴盛家园西北侧

甘肃合岳工程项目管理有限责任公司

二〇二五年六月十二日

LXZC11320250189009



第二章、投标人须知

投标须知前附表

序号	内 容 规 定
1	综合说明： 3) 项目名称：临夏县人民医院医疗设备采购项目 4) 交货时间： 第一、二包：自合同签订之日起 90 日内完成交货、安装至验收合格。 第三、四、五、六、七、八、九包：自合同签订之日起 30 日内完成交货、安装至验收合格。 3) 实施地点：临夏县人民医院指定地点 4) 招标内容： 第一包：宫腔镜（进口产品已论证）（详见采购项目需求）； 第二包：手术显微镜（进口产品已论证）（详见采购项目需求）； 第三包：心电生理网络系统（详见采购项目需求）； 第四包：体外冲击波治疗仪（详见采购项目需求）； 第五包：冲击波治疗仪（详见采购项目需求）； 第六包：高频手术设备（详见采购项目需求）； 第七包：可视喉镜（详见采购项目需求）； 第八包：血管内超声诊断仪（详见采购项目需求）； 第九包：低速冷冻离心机（详见采购项目需求） 5) 采购预算：752 万元（第一包：145 万元；第二包：135 万元；第三包：75 万元；第四包：100 万元；第五包：82 万元；第六包：60 万元；第七包：45 万元；第八包：50 万元；第九包：60 万元）
2	采购人： 1) 单位名称：临夏县人民医院 2) 单位代表：乔国海 3) 联系电话：13993038037



3	采购代理机构: 1) 单位名称: 甘肃合岳工程项目管理有限责任公司 2) 联系人: 王盼发 3) 联系电话: 15293035476
4	监管部门: 单位名称: 临夏县财政局政府采购办公室 联系电话: 0930-6668070
5	付款方式: (1) 本合同签订后支付 30%的预付款。 (2) 卖方按合同规定交货, 货到现场, 经买方核对品牌、型号、数量无误后, 凭验货物交接单及按合同总价开具的发票, 由采购人支 40%的合同货款。 (3) 所有设备经买方(使用单位)验收合格后, 凭验收合格证明后支付剩 30%货款。
6	投标人资格要求: 1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料; 2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。 3、本项目的特定资格要求: 供应商必须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》(原件彩色扫描件加盖本单位公章) 5、投标人须为在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。(适用于第四、五、六、七、八、九包)
7	联合体投标: ☐ 接受 ☒ 不接受
8	投标有效期: 90 天



9	电子投标文件的编制要求: (1) 投标人需在甘肃中工国际官网(网址: http://www.gscamce.com)下载中心中下载投标工具包,并按照使用需求安装相关软件,完成投标文件编制工作。 (2) 投标人须在开标前将加密的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至”电子服务系统”,上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。 (3) 投标文件所附证书证件均为原件扫描件,并采用企业数字证书和法人数字(即法定代表人,下同)证书签名,按招标文件要求在相应位置加盖数字证书的电子印章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或要求加盖法人数字证书电子签章的,应附法定代表人(单位负责人)身份证明;由代理人签字或要求加盖CA 数字证书(电子印章)的,应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书,签章不规范的,该投标文件将被视为无效。
10	招标代理服务费:收费标准按国家计委计价格【2002】1980 号文件规定执行,中标后由中标单位一次性付清。
11	电子投标文件提交方式及投标截止时间: 1、提交投标文件截止时间:2025 年 7 月 3 日 9 时 20 分。(北京时间) 2、投标文件递交方式:网络递交投标人须在提交投标文件截止时间前,将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至临夏州公共资源交易电子服务系统(网址: http://47.114.12.178),逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件,招标人不予受理。 3、开标地点:临夏州公共资源交易中心五楼电子开标厅(不见面开标) 4、注意: (1) 本项目采取线上递交方式,投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。 (2) 投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开标大厅(网址: http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login),并进入投标项目完成签到,开标时间到达后未签到的投标人,将不允许签到并视为放弃投标。 (3) 本项目采取远程不见面开标,请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工 不 见 面 开 标 大 厅 (网 址 : http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login),并进入参与项目



	等待开标。 (4) 本项目解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。 (5) 开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的 CA 锁完成投标文件解密等操作。 5、开标结束后五个工作日内，投标单位须做 1 份纸质版投标文件签字盖章报送至代理机构。
12	开标方式及时间： 1、开标时间：2025 年 7 月 3 日 9 时 20 分。（北京时间） 2、开标地点：临夏州公共资源交易中心电子开标厅 3、开标方式：甘肃中工不见面开标大厅（网址： http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）。
13	评标原则和办法： 综合评分法{本项目不以最低价为中标依据} 即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。具体评标因素见第六章评分办法。
14	合同数量增减变更： 合同商谈时，买方有权根据实际需要，对货物数量进行适当调整。数量增减幅度在合同金额的 10%之内。
15	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业或批发和零售业
16	中小企业扶持政策： 1、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和 财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定，对小型和微型企业产品的投标价



	格给予 10.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4、投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 7、本项目预留方式为设置专门采购包，其中第四、五、六、七、八、九包为专门面向中小企业采购，预留金额为 397 万元，预留比例为 52.8%。
17	相同品牌产品参加投标处理办法： 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
18	投标人对招标文件提出质疑的时间： 供应商应在下载招标文件之日起 7 个工作日内对招标文件的内容提出质疑，超过时效不予受理。
19	分包履约：



	1、本项目不得分包及转包，如出现，采购人有权终止合同并没收履约保证金。 2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
20	中标通知书领取时间：中标人在中标公告发布后7个工作日内与采购代理机构或采购单位联系领取中标通知书。
21	投标人须知-需要补充的其他内容： 1. 投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作； 2. 投标人操作流程 3. 社会公众可通过临夏州公共资源交易网（网址：http://47.114.12.178）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与临夏州公共资源交易活动的潜在投标人需先在在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。 4. 网上下载招标文件（或资格预审文件）开始和截止时间为（下载时间为 $n \times 24$ 小时，n 为符合国家相关法规要求发布招标文件的天数）。 5. 投标人需在甘肃中工国际官网（网址：http://www.gscamce.com）下载中心中下载投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。 6. 投标人须在开标前将加密的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至“电子服务系统”，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。 7. 投标人须在开标当日开标时间到达前，使用制作投标文件所用CA数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并按拒绝处理（由于控件可能被浏览器禁用，请投标人将不见面开标大厅地址加入信任站点和兼容性视图），系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），



投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）

8. 技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司；

客服电话：4006-1234-34；

驻场电话：15352429655

微信公众平台：甘肃中工国际

一、业务要求

1. 招标文件和投标文件必须使用招标文件规定的专用工具软件编制，并通过对应的开标系统完成投标过程。（投标工具下载地址：<https://www.gscamce.com/download>），点击新版工具选项——选择投标工具点击并下载安装，依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交，如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自负。
2. 投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。
3. 开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点登陆指定开标系统，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。
4. 投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人或系统原因，导致开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。
5. 开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，各投标人若无异议，视为默认开标全过程所有结果。



二、投标人主体信息要求

采用不见面开标后,投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据,各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效,各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题,由各投标人自行承担一切后果。

三、系统操作注意事项

1. 软硬件及网络要求

- (1) 参与不见面开标电脑须安装音响设备。
- (2) 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能,支持使用 IE 浏览器,请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上,当前版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internet explorer”子菜单中查看。
- (3) 为更好实时查看不见面开标室现场,推荐使用 20M 及以上网络宽带。

2. 开标过程注意事项

- (1) 开标当天,投标人务必于开标时间到达前登录系统,进入所投标项目,并保证联系人电话畅通。
- (2) 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息,及时查阅,并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。
- (3) 项目进入投标文件在线解密阶段后,须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密,否则将无法解密。
- (4) 为更直观了解、掌握本系统使用方法,建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册,相关操作手册可在甘肃中工国际官网—操作指南中查看,或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。



2.1 总 则

2.1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

2.1.2 有关定义

“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

“采购代理机构”（以下简称代理机构）是指甘肃合岳工程项目管理有限责任公司。

“投标人”是指向代理机构提交投标文件的供应商。

“供应商”是指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

“招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

“招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

“投标文件”是指投标人根据本招标文件向代理机构提交的全部文件。

“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。

“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。

“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。

节能产品是指财政部国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。



“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

书面形书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.1.3 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

2.1.4 合格的投标人

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

符合《投标邀请》中关于供应商资格要求的规定。

1) 关于联合体投标（若《投标邀请》接受联合体投标的）

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。



(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合《招标投标法》规定的供应商资格条件。

(3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交,明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独在同一项目中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 投标登记时,应以联合体协议中确定的主体方名义登记。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体,按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任,确定一方打分,不累加打分;评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(7) 联合体各方均为小型、微型企业的,各方均应提供《中小微企业声明函》;中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动,且《共同投标协议书》中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2) 关于关联企业

除联合体外,法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加,则评审时将同时被拒绝。

3) 关于分公司投标(除石油石化、电力、通信、银行、金融、保险等特殊行业外,本项目不接受非独立法人单位分公司的投标)分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的,应提供总公司的营业执照副本扫描件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具的授权书。已由总公司授权的,总公司取得的相关资质证书对分公司有效,法律法规或者行业另有规定的除外。



4) 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5) 关于中小微企业投标

1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中 小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人 为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提 供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、供应商提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商 标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发 展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的 为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理 局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒 管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产 建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上 监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

6、中标供应商为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

7、中标供应商为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性 单位声明函》，接受社会监督。

2.1.5 投标费用

无论招标的结果如何，供应商应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。



2.1.6 节能产品

对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库[2019]19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库[2019]18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

2.2 招标文件

2.2.1 招标文件的构成

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.2.2 招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。



2.3 投标文件

2.3.1 要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受投标机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.3.2 投标文件构成

投标人编写的投标文件应由资审文件（包括资格证明文件）、商务文件和技术文件（包括技术响应、样本资料等）组成，建议按如下顺序编制：

1) 投标人资格证明文件

投标人必须按照第六章电子投标文件格式中资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

2) 商务文件部分应包括：

- (1) 投标函
- (2) 投标人基本情况表及人员情况表
- (3) 产品质量与售后服务承诺函
- (4) 投标单位承诺函、同意招标文件条款声明、虚假应标承担责任声明等
- (5) 投标人近三年已完成类似项目一览表
- (6) 投标报价表
- (7) 投标人认为需要提供的其他文件和资料

3) 技术文件部分应包括：

- (1) 投标货物偏离表
- (2) 产品彩页或说明书等技术支持资料
- (3) 技术方案、项目实施方案



(4) 完善的售后服务方案

(5) 投标人认为需要提供的其他文件和资料

证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并在装运货物时出具原产地证书证实。

证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、用户证明，包括：

a. 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物、服务已对买方的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外；（填写“技术要求响应/偏差表”和/或附加详细说明）

b. 货物的主要技术指标和性能的详细说明，至少应包括对招标文件提出的指标的响应；（根据需要填写“投标货物说明表”、提供系统建设方案，附加产品详细说明及产品的第三方测试报告）

c. 提供项目实施计划，说明投标人将在被授标后，如何利用人力及其他资源来承担其合同项下整体的管理和协调责任。该计划应包括详细的、以进度表表示的合同执行计划，标明完成合同所有关键活动的预计时间、顺序和内在联系。项目实施计划还应说明在合同执行期间，需要买方和其它有关方所做的工作，以及建议采购人如何对有关各方活动进行协调。（此项目实施计划将在中标后，加上买方的确认意见，作为合同附件一部分）

d. 投标人书面承诺：将承担起如招标文件要求的、对合同组成部分进行集成和协调的责任，并提供包括培训计划的技术支持和售后服务方案。

投标人在阐述上述 b 项时应注意：采购人在技术规格中指出的设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求，并且使采购人满意。



注：①提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

②资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

③投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

④依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，须提供相应的证明文件（清晰、真实、有效）

2.3.3 投标报价

投标报价应以货到项目现场为基础，包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。

投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“投标报价表”。投标人应在投标报价表上标明对本次投标拟提供的货物和服务的价格，包括单价和总价。如果单价与总价不符，以单价为准。

投标人不得零报价；投标产品涉及办公设备和办公家具的报价不得超出《通用办公设备和办公家具配置标准》（详见附件）；在评标过程中评标委员会认为报价不合理或低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求投标人在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明，否则，评标委员会可以取消该投标人的资格。

投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

注：网上开评标系统中提交的开标一览表投标报价金额单位为元，请投标人认真核对投标报价单位，以免造成无效投标。

2.3.4 投标有效期

投标文件应在本投标人须知规定的投标截止时间之后开始生效，在正式递交日期起90日内有效。

2.3.5 电子投标文件的编制要求

（1）投标人需在甘肃中工国际官网（网址：<http://www.gscamce.com>）下载中心



中下载投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。

(2) 投标人须在开标前将加密的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至“电子服务系统”，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。

(3) 投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用企业数字证书和法人数字(即法定代表人，下同)证书签名，按招标文件要求在相应位置加盖数字证书的电子印章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或要求加盖法人数字证书电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明；由代理人签字或要求加盖 CA 数字证书(电子印章)的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书，签章不规范的，该投标文件将被视为无效。

2.3.6 电子投标文件的递交

本项目采用网上电子投标方式，不接受投标供应商递交的纸质电子投标文件，投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至临夏州公共资源交易电子服务系统（网址：<http://47.114.12.178>），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。

本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

2.4 开标和评标

2.4.1 开标

开标时间到达后，启动网上开标会，系统会自动获取到已经进入开标厅并完成投标操作的投标人列表；在线通知投标人开始核验投标文件，并通过开评标系统提供在线指导服务。在所有投标人完成投标文件有效性核验以后，系统自动提取通过核验的固化文件中的投标报价表，生成开标记录表。

投标人不足 3 家的，不得开标。

开标结束后，投标人必须对开标标的内容进行确认，不确认的视为认可开标结果。

2.4.2 评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其



中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

- 1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
- 2) 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。
- 3) 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
- 4) 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。
- 5) 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。
- 6) 法律、法规和规章规定的其他义务。

评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

- 1) 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者集采机构，不得私自转托他人。
- 2) 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或集采机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或



担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3) 评审或咨询过程中不得把通讯设备带进评标室，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4) 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5) 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

2.4.3 评标（详见第五章）

2.4.4 其他事项

1) 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2) 在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

3) 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

4) 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。



2.5 废标和串通投标

2.5.1 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

2.5.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装。

2.5.3 采购方式的变更

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 43 条规定，经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

2.6 中标通知书

2.6.1 中标人的确定

本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在甘肃政府采购网和临夏州公共资源交易上公告中标结果。中标公告期限为一个工作日。

2.6.2 中标通知书

中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.7 合同签订及履行



2.7.1 签订合同

中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

中标人在合同签订后，由采购人或中标人向省级财政监管部门备案。

2.7.2 履约保证金

若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其承担相关责任和义务。

中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

2.7.3 合同验收

1) 货物验收：(1) 投标人向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和投标人依据供货清单共同对货物进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查。

(2) 验收以最终用户地验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由投标人提供货物保修文件。

(3) 项目完成地点（安装地点）：投标货物交付、安装使用地点为采购人在采购合同中指定地点。



2) 合同验收：采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。采购预算在 1000 万元以上的大型政府采购项目，还应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

2.8 其他规定

2.8.1 采购代理服务 fee

收费标准按国家计委计价格【2002】1980 号文件规定执行， 中标后由中标单位一次性付清。

2.8.2 其他

关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则：无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形， 即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

中标后招标文件和投标文件未尽事宜根据法律法规另行商定。本招标文件由代理机构负责解释。



第三章、询问和质疑

3.1 询问

3.1.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

3.1.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

3.2 质疑

3.2.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。对招标文件的质疑期限为在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内。

3.2.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和委托代理人身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.2.3 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

3.2.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十条，投标人对



采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

3.2.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

3.2.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 对招标文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；
- (5) 未在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (6) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (7) 其它不符合受理条件的情形。

3.3 质疑地点及联系方式：

采购人：临夏县人民医院

联系人：乔国海

联系电话：13993038037

单位地址：甘肃省临夏县双城新区

代理机构：甘肃合岳工程项目管理有限责任公司

联系人：王盼发

联系电话：15293035476

单位地址：甘肃省临夏州临夏市红园街道西城壕路 33 号商铺

监管单位：临夏县财政局政府采购办公室

联系电话：0930-6668070

单位地址：临夏县榆丰路兴盛家园西北侧



第四章、采购项目需求

4.1 设备名称和数量:

第一包:

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	宫腔镜(进口产品已论证)	一、配置需求 (一) 超高清宫腔镜检查镜 1 套 (二) 超高清双极等离子宫腔电切镜 1 套 (三) 智能型高频电刀 1 台 (四) 液体膨宫泵一台 (五) 超高清摄像系统: 超高清数字摄像主机 1 套 (六) 冷光源: 300W 氙灯冷光源 1 台 (七) 超高清监视器: 超高清 4K 监视器 1 台 (八) 专用台车 1 台 (九) 超高清图文工作站 1 套 二、配置参数 (一) 摄像系统主机 1. 数字化信号处理, 图像色彩逼真, 分辨率高, 色彩还原性好。 ▲2. 特殊光电子染色技术: 可将特殊光照射后获得的影像进行处理并形成特殊的影像, 便于早期子宫内膜癌的观察及诊疗。 3. HDTV 信号输出: 可以选择模拟信号 RGB、YPbPr 或数字信号 SDI、DVI, 保证高保真度的图像输出。 4. SDTV 信号输出: VBS 复合视频信号, Y/C, RGB 和 YpbPr 同步输出. SDI 及 DVI 数字信号输出。 5. 具备 16: 10、16: 9、5: 4 及 4: 3 图像格式比例输出。 6. LVDS 技术, 保证信号的优化输出。 ▲7. 3D 降噪技术, 降低图像噪点, 使信号输出更加优化。 8. 可根据医院需求进行如记录静态、动态图像存储及输出、画中画显示等功能	1	套



	9. 可以使用面板按钮或遥控开关进行白平衡调节。 10. 自动增益（AGC）：自动调整图像亮度，保证最佳手术视野。 11. 镜子的把持部位有遥控开关；可对常用功能进行设定；如记录储存图像、轮廓强调、画中画、白平衡等。 12. 内置 USB 接口，可对图像进行进行储存及对术者使用习惯的设置进行储存。 13. IRIS（测光）：具有 PEAK（峰值）、Average（平均）和 AUTO（自动）测光模式。 14. 影像增强设置：采用电子增强的方式强化内镜影像的细节或边缘，增强影像锐利度，有三种结构增强水平和三种轮廓增强水平。 15. 根据用户习惯，有 5 种光源颜色模式可供选择。 ▲16. 色调调节：红色、蓝色和色度各有一8~+8 的级别调节。 17. 可以把图象放大到 1.2×，1.5×，或 2.0×。 18. 具备齐全的外科软性电子及纤维内镜技术，并且能够兼容同品牌电子及纤维软镜。 ▲19. 可兼容高清 3 镜片摄像头、高清摄像头、高清电子腹腔镜及标清电子腹腔镜以及高清电子胃镜、结肠镜等。 20. 对比度：可将影像的对比度设定为 H（高）、N（正常）和 L（低）3 档。 21. 预冻结：在冻结操作和显示前的设定时间段内，从采集图像中选择带最少彩虹色的画面。 22. 保修二年。 （二）高辉度氙灯光源 1. 氙气短弧灯。 ▲2. 特殊光生成：可将氙气灯产生的普通白光进行处理，生成特殊光。 3. 通过调光电缆与摄像主机相连，进行自动调光。 4. 有一个应急的 35W 后备灯泡，可在光源故障情况下进行自动切换，连续使用 500 小时。	
--	--	--



	5. 可以和多种不同品牌的导光束相连。 ▲6. 有 17 档自动曝光满足自动亮度控制 。 7. 亮度强度模式有正常及高强度可供选择。 8. 保修二年。 （三）超高清宫腔检查镜 1、蓝宝石非球面柱状透镜，可配合宫腔镜管鞘提供优质的图象； 2、检查治疗镜为 3 mm 30° ，管鞘可持续灌流, 表面磨沙处理； 治疗镜管鞘可通过 7Fr 手术器械； 所有管鞘均可高温高压消毒； 镜体保修二年 （四）超高清双极等离子宫腔电切镜 1、外径 4mm，视野方向 12 度 2、广角镜头，视野范围广 3、非球面镜，无畸变，可高温高压灭菌 4、柱状透镜组，亮度、清晰度提高 5、持续灌流，可旋转，保持视野清晰，方便操作 ▲6、陶瓷先端斜行设计，管流效率大大提高 7、光学视管与管鞘直插式锁定，方便稳定 8、镜体保修二年 （五）智能型高频电刀 1. 与摄像系统设备同一品牌；适合开放手术及内窥镜下的电气手术。 ▲2. 有单极；双极；生理盐水≥3 种输出模式。 3. 可与超声刀凝固/切割系统并用，用于组织切除。 4. 可以和自动排烟装置连接自动排除手术中电切（凝）产生的烟雾。 5. 具有软性镜保护回路接口，适用于所有软性内窥镜包括纤维镜的电凝治疗。 6. 单极输出模式：电切模式：3 种（单切、混合、URO）；凝固模	
--	--	--



	式：3种（凝固1、凝固2、喷射）。 7. 双极输出模式：电切模式1种（单切）；凝固模式3种（软1、软2、硬）。 8. 生理盐水输出模式：可以在生理盐水冲洗下做前列腺及膀胱、宫腔电切等手术；电切模式2种（单切、混合）；凝固模式2种（凝固1、凝固2、）。 9. 单极最大输出功率和调节档位：单切：300W、混合：250W、URO:300W、凝固1：120W、凝固2:120W、喷射：120W；调节档位：每档5W； 10. 双极最大输出功率和调节档位：单切：90W、软1：90W、软2:90W、;档位调节：0—20W 每档1W、20W-30W 每档2W、30W-90W：每档5W;硬 L1：80W、L2：120W、L2：160W, 调节档位：每档一级 11. 生理盐水最大输出功率：单切：320W、混合：320W、凝固1：200W、凝2：80W;每档5W 12. 额定阻抗：单极300 欧姆；双极200 欧姆（硬50 欧姆） 13. 输出时间：10 秒开30 秒关（持续输出时间不要超过10 秒） 14. 具备自检功能，探测各种安全监控功能是否正常，如有异常立即报警并显示出错编码 15. 单极单切最大输出功率320W；双极单切最大输出功率为90W，生理盐水下最大切割功率为320W 16. 适用领域：外科手术领域，包括胃，肠，肝，泌尿及妇科等； 17. 输出控制：由脚踏开关、手动开关控制； 18. 可以在触摸屏显示的设置界面上进行设置，操作更简便； （六）液体膨宫机 1. 可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。 2. 可调节预设压力，调节范围15-150mmHg，压力控制精确，最高压力域值≤150 mmHg。 3. 可调节预设流速为50-500 mL/min 。 ▲4. 实时显示液体泵入量。	
--	--	--



	5. 蠕动式泵头。 6. 具有自动提示功能及维修识别功能。 ▲7. 具有器械校准功能。 8. 自带流速记忆功能。 9. 压力调节 5mmHg 一个档位，可任意调节。 10. 流量调节 50ml/min 一个档位，可任意调节。 11. 具有过压提示功能，当实际压力大于设置压力 10mmHg 并且持续 5s 后会触发，具有图形显示和声音提示。 （七）超高清 4K 监视器 1. 尺寸≥27 英寸 2. 分辨率≥3840*2160 （八）超高清图文工作站 1. 采用超高清图像采集卡，可实现 SDI 超高清视频采集（1920*1080）。 2. 采集的动态视频可进行二次提取，且提取的静态图像无模糊与拉毛现象。 3. 系统全面集图像后处理功能，可实现动态录像的编辑，支持分割、合并、字幕合成、视频格式转换、图像提取等功能，完全能够满足科室的临床、教学、科研的需求； 4. 自动初复诊提醒判断功能，减少误诊漏诊的情况； 5. 支持图像的自动裁剪； 6. 报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告； 7. 提供脚踏开关控制采集图片、录像操作； 8. 系统具有审核机制，满足科室的质量管理需求； 9. 静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响； （九）专用台车 1. LCD 固定臂可作高度、左右、前后调节，方便使用者在各个角度观察监视器。	
--	--	--



		2. 具有太空塑料耐热、耐压、防震； 3. 监视器平台能 180 度旋转，可上下调节。
--	--	--

核心产品：宫腔镜（进口产品已论证）

LXZC11320250189009



第二包:

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	手术显微镜 (进口产品已论证)	一、光学系统 1.1 适用于神经外科等多科室显微手术使用; 1.2 一体化触摸屏集控系统 1.3 全光路复消色差高级镀膜工艺; ▲1.4 无级变倍系统,放大倍数:最小放大倍率$\leq 2X$,最大放大倍率$\geq 16X$(12.5倍目镜下); ▲1.5 单一连续可调物镜下,最小工作距离$\leq 200\text{ mm}$,最大工作距离$\geq 600\text{mm}$; ▲1.6 广角目镜屈光补偿范围: $+5D/-6D$,眼杯高度可调; 1.7 主刀镜: 12.5X 双目镜筒, 0-180 可调镜座; 1.8 全功能可编程手柄,可自由设定控制参数,功能≥ 8项; 1.9 智能远程诊断: 无外挂模块,可通过全内置主机的远程服务平台实现远程机器使用日志、报错和故障排除等售后服务功能; 二、照明系统 2.1 支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜; 2.2 照明光源: 内置 LED 照明系统,使用寿命长,使用成本低 2.3 照明安全: 光亮度和工作距离联动,光照范围与术野联动; 2.4 自动调节亮度: 为了实现目镜中稳定的图片亮度,根据工作距离和放大倍率调整照明亮度; 三、支架系统 ▲3.1 平衡调节: 电动平衡系统,可电动调节显微镜至平衡状态; 3.2 智能防震颤支架: 支架采用智能感应减震马达,使支架快速减震停摆; ▲3.3 过顶设计,支架最大高度$\geq 2200\text{mm}$,有效臂展$\geq 1600\text{mm}$; 3.4 支架系统具有自动抽真空功能 四、摄像系统 ▲4.1 原厂内置一体化设计,完全内置有原厂高清摄像头	1	套



		(1920*1080p)，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理； 4.2 视频输出端口 HDMI、DVI-D、HD-SDI, 网络端口，照片格式包含 JPEG、PNG； 五、管理系统 ▲5.1 一体化触摸屏集控系统：通过 24 英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限； 5.2 局域网：可连接局域网； 5.3 远程维修系统：通过远程访问显微镜诊断故障。	
--	--	--	--

核心产品：手术显微镜（进口产品已论证）

LXZC11320250189009



第三包：

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	心电电生理网络系统	1 整体要求 1) 系统采用微服务技术架构, 各服务之间高度自治, 支持独立部署或集中部署, 满足医院业务高并发的需求。 2) 数据库支持 SQL Server、Mysql 等数据库, 采用读写分离模式。 3) 采用热部署方式, 无需停止服务器即可实现系统程序升级发布、配置文件更新等功能。 4) 系统支持 C/S 和 B/S 混合模式。 5) 系统采用业务和管理分离的方式。在业务处理上, 提供独立的医生工作站, 供临床处理心电的检查、诊断、数据分析等业务; 在管理上, 提供独立的管理后台, 实现对人员、设备等基础数据的统一管理, 支持创建、修改、删除、查询各通行证功能。通过业务口和管理口从物理上分离, 使业务数据和管理数据相互间不会产生干扰, 提升系统稳定性和可靠性。【提供证明业务和管理分离的软件功能截图】 ▲6) 支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理, 记录每一份心电报告的生成过程, 为功能调试、问题排查、问题定位等提供技术支撑和可靠保障。【提供心电业务分析及运维监管系统自主知识产权证明】 7) 系统安全应符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》。 8) 系统提供接口服务, 支持对接第三方信息平台, 支持采用视图、存储过程、Webservice、DICOM、HL7 等方式实现接口功能。 ▲9) 系统有经过 IHE 数字心电诊断系统集成模式和功能角色的专项测试, 可以满足与医疗卫生机构信息系统和设备之间的信息互联、互通、集成共享的要求。集成模式至少包含 REWF、ECG、DRPT 等 3 类, 功能角色至少包含 EC、ID、INTEGRATED-ECG-MANAGER、INFO_SRC、Integrated Report Manager/Repository 等 5 种。【提	1	套



	供通过测试的证明文件】。 10) 系统具有自动正时功能，支持与医院时间服务器同步，实现联网心电图机、工作站时间统一。 2、预约叫号 1) 支持检查诊室管理功能，包括新建、修改、删除。 2) 支持设置预约时段、关联诊室，每个预约时段可限制人数；支持一个诊室对应多个检查项目，支持一个检查项目多个诊室检查。 3) 支持静息心电、动态心电、动态血压、电生理等多种业务类型统一预约。 4) 检查医生通过 HIS 接口获得申请单进行登记和预约，并生成排队号的条形码，患者按照排队号在检查室等待检查。 5) 可手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录获取检查患者。 6) 在预约列表中，支持新建、修改、删除、加急、激活等功能。 7) 支持选择检查项目，支持填写主诉、临床诊断、既往病史等信息。 8) 支持手动选择或自动匹配检查诊室和检查时段。 9) 具有时段预约已满智能提醒功能。 10) 支持预约登记患者更换诊室、加急、激活、打印预约单。 11) 支持呼叫、检查、过号、重呼、激活等功能 12) 支持大屏展示排队叫号信息，方便受检者在候诊大厅的大屏随时掌握自己的就诊动态 13) 依序叫号，系统会自动语音呼叫，并在叫号屏上显示 14) 支持自定义大屏模板样式，配置显示内容，包括叫号队列、候诊队列、过号队列、姓名、排队号、检查诊室、检查项目等内容配置显示。 15) 支持多语言播报。 3、检查管理 1) 系统支持连接第三方心电图机完成受检者的心电检查。支持解	
--	--	--



	析 hl7、mfer、scp、fda-xml、dicom、anb、dat、ecg、eco、ekg 等第三方心电图机数据格式并以统一的格式进行存储。 2) 支持针对门诊（固定检查）、病房（移动检查）等不同的检查场景，按照所接设备类型，可以提供不同的设备接入和改造方案。满足不同场景下的设备接入和采集需求。 3) 具备网络传输功能的心电图机，数据采集完成后可通过无线或有线方式直接发送至心电中心服务器，由诊断中心进行集中诊断。 4) 支持对不具备网络传输功能的心电图机进行数字化改造，可兼容不同品牌型号的心电图机、采集盒以及其他检查设备。 5) 移动场景下，支持第三方心电图机先离线采集再集中上传，无需借助 PC、平板等即可通过网络直传诊断中心。 6) 固定场景下，支持将现有心电设备直接连接电脑来实现心电数据接收，支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取检查信息，支持设置加急和隐私患者处理。 7) 支持配置检查模式，可选常规十二导、常规十五导、常规十八导、心向量、心率变异、QT 离散度、频谱心电、阿托品等。 ▲8) 支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等实时提醒。【提供伪差、导联脱落、左右手接反实时提醒功能证明】 9) 支持图谱采集完成后预览，支持加采、重采功能； 10) 采集完成后支持自动分析危急值，分析结果包括以下几种类型：危急、阳性、正常、采集不良、未分析。 11) 支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。 4、医生工作站 ▲1) 为满足医院业务发展需要，医生工作站须提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具。【提供功能界面截图及静息动态心电血	
--	---	--



	压综合分析系统自主知识产权证明】 静息心电分析： 2) 心电图诊断报告系统具备权限管理功能，给不同的医生进行权限配置。 3) 接收到远程诊断申请后，系统支持后台预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，在客户端、web 端、移动端以弹窗、消息等多种方式向诊断医生预警。 4) 支持诊断医生对不符合要求的图谱进行退回、加采、重采等操作；支持退回加采/重采报告加注原因。 5) 系统支持设置强制审核模式，设置为强制审核模式的报告必须进行双签之后才能发布，以满足医院多业务形态的需要。 6) 为提高医生工作效率，系统支持同屏显示报告列表和看图界面。可直接在看图页中查看列表数据，无需在列表页和详情页中来回切换。 7) 支持导联布局、走速、增益、滤波调整等操作 8) 支持查看图谱波形展示方式切换，可使用同步导联或连续导联模式展示，支持查看图谱总时长。 9) 支持在图谱上通过测量工具测量某段波形的电压值、心率和间期测值。 10) 支持心搏放大功能，通过心搏放大查看某个心搏，调整波形形态识别后重新发送测值。 11) 系统具备并行分规功能。 12) 支持在心电图波形区域的异常位置做标记，提供图像注释说明记录。 13) 支持组合导联功能：使用十二导设备采集两份十二导数据合并为十八导数据，满足附加导联的检查要求。 ▲14) 提供典型病例收藏功能，支持医生自定义收藏分类，为医生后期培训和进行科研提供素材。【提供典型库收藏管理系统自主知识产权证明文件】	
--	--	--



	15) 支持导联纠错功能,在肢体导联接反或胸导联接错的情况下,可以通过软件直接修正,无需重新采集。 16) 支持漏诊提示,对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示,防止造成漏诊。 17) 支持图谱对比功能,支持将 5 份及以上历史报告加入对比,可引用对比报告的诊断结论。 18) 支持叠加波分析,可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。 19) 支持测值超过正常范围,显示成红色,且测值有最大和最小值限制。 20) 支持测值根据词条联动,如死亡心电图/无心电活动:所有测值置“/”,房颤:房率、P 波时限、PR 间期、P 电轴置“/”,房扑:P 波时限、PR 间期、P 电轴置“/”。 21) 支持胸痛加急功能,诊断界面有胸痛加急按钮,点击之后有胸痛加急的提示弹窗并可将检查完成消息推送到手机微信端。 ▲22) 提供标准的心电图诊断词条,辅助医生快速进行报告编辑,在编辑过程中支持词条模糊查询及词条与测值的联动。【提供心电专家智库系统自主知识产权证明】 23) 支持 ST Map 功能。 ▲24) 支持梯形图生成技术。【提供梯形图功能经药监局注册检验的证明】 25) 支持频谱心电、高频心电、QT 离散度、心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能。 ▲26) 支持阿托品等药物试验功能,可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。【提供阿托品药物试验功能经药监局注册检验的证明】 27) 支持心电自动诊断技术,对心电报告进行自动化分析和诊断,辅助诊断医生进行报告诊断,提高诊断效率和质量。 28) 可依据自动诊断结果提供危急值预警功能,通过微信等方式自动推送到相关人员手机上,提醒医护人员及时关注危急心电图。	
--	--	--



	29) 客户端、Web 端、移动端支持自动诊断分析结论，可手动选择是否引用自动诊断结论。 ▲30) 支持在诊断界面将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享，通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。【需提供软件界面截图证明及承诺函】 31) 为保护受检者信息安全，报告分享支持脱敏显示。 32) 支持修改系统名称及系统 logo，实现个性化订制。 5、移动会诊 1) 移动会诊支持手机端 H5 的方式实现原始心电图数据的查看，支持 Android 和 iOS 系统等各种品牌终端，满足出差、居家等不同场景下的远程会诊需求。 2) 支持手机端报告任务列表刷新功能，可实时查看待处理报告的数量。支持报告编辑功能，提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入诊断词条，辅助医生快速的进行报告编辑。 3) 支持手机端浏览器访问登录功能；支持记录最近一次登录用户。 4) 支持 iPad 端诊断，方便医生值班时使用。支持报告列表功能、支持多份心电图切换功能、支持报告编辑功能；支持通过扫描二维码的方式连接服务器地址，免去繁杂的网址输入过程，防止服务器地址外泄，提高系统安全性。 5) 系统支持将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。会诊专家可在微信端查看原始心电数据，支持走速、增益的调整，支持导联布局的切换，支持心电波形的滤波。 6、临床 web 端调阅 1) 支持在 Web 端查看、诊断、发布心电图报告。满足不同场景的业务需求。 2) 支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量。	
--	---	--



	3) 支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告。 4) 支持产生新报告到达即时提醒功能。当检查端采集的病历发送过来时, web 端自动弹出提示窗口并语音提醒, 提示医生有新报告到达。 5) Web 终端可查看原始数据, 支持调整导联布局、增益、走速及; 支持心电波形的滤波, 包括肌电滤波、工频滤波、高频滤波; 提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入; 支持修改受检者部分信息; 支持全院数据共享。 7、数据统计与质控管理 ▲1) 利用大数据可视化系统, 通过对医院心电检查、诊断、资源分布等数据的分析挖掘, 为院内的业务开展和资源分配提供数据支撑。【提供心电大数据展示系统自主知识产权证明】 2) 统计分析: 实现管理部门对病种、医生、检查报告的统计分析。 3) 支持根据机构、诊断中心查看报告检查量、诊断量。 4) 支持诊断来源分布统计。 5) 支持危急值统计分析, 支持列表和柱状图展示。 ▲6) 支持通过心电人工智能进行质控分析, 评估诊断医生和诊断组的诊断质量, 进一步明确后续的培训方向和提高培训效果。【提供心电人工智能质控中心系统自主知识产权证明】 8、基础数据管理 1) 要求系统具有完整的分级权限管理系统, 可针对不同人员授予不同的权限, 使用者只能做已授权的操作。 2) 支持对科室部门进行统一管理, 并提供了添加科室部门、修改科室部门、删除科室部门、查询科室部门的功能。 3) 支持诊断分组功能, 包括新增、修改、删除; 支持诊断分组关联医护。 4) 支持诊断分组配置诊断调度规则。 5) 支持通过数据字典对系统内容进行维护。	
--	--	--



		9、网络安全 1) 系统具备应对登录的用户进行身份标识和鉴别,身份标识具有唯一性,身份鉴别信息具有复杂度要求并支持定期更换;提供密码强度提示及强度设置要求校验,提供密码定期更换周期设置。 2) 具有首次登录更换密码设置,支持强制要求首次登录更换密码设置。 3) 具有登录失败处理功能,配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施; 4) 支持日志审计功能,具有操作记录日志。 5) 支持日志管理功能。 10、心电电生理设备接入 ▲1) 为充分利用现有设备,系统需支持连接医院现有不同品牌与型号的心电图设备,支持采集原始数据,不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据,并以标准的数据格式存储,实现心电数据分析,支持接入心电图设备的数据归档和管理。【提供支持第三方设备集成相关证明】 ▲2) 支持对电生理报告的自动解析,并可进行归档、生成电生理报告,报告可院内共享。【需要提供经药监局注册检验的证明资料】 3) 支持电生理设备包括 Holter、运动平板、动态血压、脑电图、肌电图、TCD、听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。可根据临床实际需要,支持重新定义报告格式,并且可对电生理参数进行相应的统计分析。 4) 支持电生理数据归档和管理,数据经过归档后,在科室内实现数字化管理和院内数据共享。 5) 电生理报告支持 CA 签名。 11、系统集成 1) 支持医院与第三方信息系统(HIS 等)心电图相关的信息(检查申请单、检查状态回写、报告状态回写、结论回写)交互。	
--	--	---	--



	2) 支持第三方系统调阅心电图报告, 可浏览并打印心电图报告。 12、数字式心电图机 (15 台): 1) 导数字式心电图机, 支持 12 导心电图同步采集; ▲2) 支持 12 导心电+心向量同步采集【提供软件截图和产品制造商公开发布的资料证明】; ▲3) 心电图机一体化平板设计, 采集仪模块内置; 主机全触控操作, 无物理硬按键。【提供产品制造商公开发布的资料证明】 4) 显示屏幕≥10 英寸 5) 具备 LAN、USB 等传输接口 6) 支持智能操作系统, 可远程更新升级 ▲7) 设备属于 CF 型防除颤类型, 提供设备铭牌图片证明, 具有 CF 型防除颤图标。 8) 心电图主机支持 2.4GHz/5GHz 双频段无线 Wi-Fi 9) 耐极化电压: $\pm 600\text{mV}$ ▲10) 定标电压: $1\text{mV} \pm 1\%$【提供医疗器械注册证相关证明材料】 ▲11) 共模抑制比: $>125\text{dB}$ (默认交流滤波关闭)【提供医疗器械注册证相关证明材料】 ▲12) 内部噪声: $\leq 10 \mu\text{V-P}$【提供医疗器械注册证相关证明材料】 13) 频响范围: $0.05\text{Hz} \sim 350\text{Hz}$ ($-30\% \sim +10\%$) 14) 存储量: 支持 10000 份心电数据存储 ▲15) 锂电池额定容量$\geq 8000\text{mAh}$, 支持 8 小时以上连续工作【提供产品说明书证明】 ▲16) 具备支持全导联起搏检测, 准确识别起搏信号【提供医疗器械注册证相关证明材料】 17) QTc 参数测量: 内置 6 种及以上测量算法, QTc 计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供 QTc 算法功能截图证明材料】 18) 心电图机支持批量下载预约记录功能, 并支持待检查列表显示, 列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。	
--	--	--



	19) 心电图机支持本地报告进行同屏对比【提供功能截图证明材料】 20) 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。 21) 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。 ▲22) 对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。【提供急性心肌梗死预警系统相关的软件著作权证书复印件证明】 23) 图谱采集具备自动记录功能，设置菜单中可设置图谱最小采集时长为 10 秒、20 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟、10 分钟、20 分钟、30 分钟或者 10-1800 秒中的任意时长。 24) 记录测值包括：心率、电轴、P 波时限、P-R 间期、QRS 时限、Q-T 间期、QTc、T 波、Rv5、Sv1 等。 ▲25) 支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。【需提供软件界面截图证明及承诺函】 ▲26) 阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 27) 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 ▲28) 梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 29) 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能 ▲30) 包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。 31) 专用移动推车： 组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手	
--	--	--



		车轮说明：由 5 个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能， 车轮材料包括橡胶，金属，塑胶。
--	--	---

核心产品：心电电生理网络系统

LXZC11320250189009



第四包：

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	体外冲击波治疗仪	一、技术规格要求 1、原理：手柄为气压弹道式原理设计（非电磁式）。 2、主机、手柄、探头为同一品牌同一制造商生产。 3、控制界面：主机使用触摸板仪表圆盘调节治疗气压输出大小，方便精确调节气压输出大小。 二、产品性能要求 ▲1、手柄冲击头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果。 ▲2、所有冲击头均带有施压指示器，带压力刻度。 ▲3、手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数。 4、设备配置恒定能量手柄一把（含 5 个不同规格钛合金冲击头） 5、手柄可+134℃高温高压消毒。 6、采用外置减振式全封闭空气压缩机，压缩机与主机分体式设计，减少空压机对主机的干扰，治疗过程中低噪音。 7、配套专用推车，用于压缩机放置，便于使用者移动。 8、主机单次治疗设置次数可选择 0-2500 次。 9、工作压力：1.5bar - 4bar 治疗时连续可调 10、最大正输出压力：不小于 11.2MPa 11、能流密度：≤0.55mJ/mm² 12、工作频率：4、8、12、20HZ 可供选择 13、设备用于治疗人体骨骼软组织慢性疼痛。主要如： 肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合征、网球肘、股骨大转子疼痛综合征、髌骨尖综合征、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧应力综合征、止点性跟腱炎、非止点性跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合征、特异性和根性腰背疼痛综合征。	2	台

核心产品：体外冲击波治疗仪



第五包：

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	冲击波治疗仪	1. 使用用途：用于泌尿系结石碎石治疗 2. 波源类型：电磁式冲击波源，透镜式聚焦； （1）电容最大储能：60.5~128J； （2）高压放电范围：11kV~16kV； ▲（3）冲击波治疗深度$\geq 150\text{mm}$, 可变焦；（提供注册证或检测报告证明）； ▲（4）第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿为$\leq 0.5\ \mu\text{S}$，脉宽$\leq 1\ \mu\text{S}$； （5）压缩声压峰值 10~60MPa；膨胀声压峰值$\leq 9\text{MPa}$； （6）聚焦范围径向$\leq 15\text{mm}$，轴向$\leq 110\text{mm}$； （7）具备冲击波高频高压系统，保证冲击波能量的稳定性； （8）电源条件：单相 220V； 3、冲击波治疗头 ▲(1)冲击波源运动臂转动角度范围$\geq 200^\circ$，误差$\leq \pm 5^\circ$；升降范围$\geq 300\text{mm}$；误差$\leq \pm 5\text{mm}$； (2)冲击波源摆动角度范围 50°，可选择多角度碎石； ▲(3)治疗臂可随主机独立转动范围$\geq 90^\circ$，更容易实现治疗臂翻转功能； 4. 超声定位系统： ▲（1）具备超声图像辅助一键对位功能； （2）环冲击波源锥形多角度运动的 B 超探头定位装置，具备电子自动测距，数字自动显示功能； （3）探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差$\leq 2\text{mm}$； （4）探头表面与第二焦点测距误差$\leq 2\text{mm}$； （5）探头具备伸缩功能，行程 25-125mm； （6）定位装置最小移位精度$\leq 1\text{mm}$；	1	套



	5、操作控制系统： （1）整机采用数控 MCU 专业碎石控制操作系统，液晶触摸屏全面显示设备状态信息； ▲（2）可移动式液晶触摸屏控制台，带摇杆运动控制系统； （3）碎石触发频率范围：60～120 次/分钟之间自由调整； （4）冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能，有效降低冲击波能量衰减，保证有效治疗； ▲（5）、辅助定位系统：导航功能可实现：治疗术前一键运动复位；超声影像治疗术前一键导航自动定位，焦点探测距离可视化，焦点定位跟踪可视化； 6、治疗床与主机： ▲（1）可与主机分离的独立的移动式多功能手术床；治疗床全电动控制，三维六向运动：上下升降范围≥150mm，纵向移动范围≥150mm，横向移动范围≥150mm； （2）治疗床为三段可拆装式（含床主体、头板、尾板），可配置泌尿外科专用附件（如脚托、压腹带）； （3）机械传动系统最小调节精度≤1mm； （4）治疗床有效载荷 ≥135Kg； 7、产品配置要求 <table><tr><td>（1）治疗床</td><td>1 台</td></tr><tr><td>（2）主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>（3）电气柜</td><td>1 台</td></tr><tr><td>（4）控制台（10 寸触控屏摇杆操作）</td><td>1 台</td></tr><tr><td>（5）冲击波源(电磁式声学透镜聚焦)</td><td>1 套</td></tr><tr><td>（6）电容箱(真空高压脉冲触发)</td><td>1 套</td></tr><tr><td>（7）冲击波高频高压发生器</td><td>1 套</td></tr><tr><td>（8）水处理器</td><td>1 套</td></tr><tr><td>（9）病案管理系统（含一键对位超声辅助定位系统）</td><td></td></tr></table>	（1）治疗床	1 台	（2）主机	1 台	（3）电气柜	1 台	（4）控制台（10 寸触控屏摇杆操作）	1 台	（5）冲击波源(电磁式声学透镜聚焦)	1 套	（6）电容箱(真空高压脉冲触发)	1 套	（7）冲击波高频高压发生器	1 套	（8）水处理器	1 套	（9）病案管理系统（含一键对位超声辅助定位系统）		
（1）治疗床	1 台																			
（2）主机	1 台																			
（3）电气柜	1 台																			
（4）控制台（10 寸触控屏摇杆操作）	1 台																			
（5）冲击波源(电磁式声学透镜聚焦)	1 套																			
（6）电容箱(真空高压脉冲触发)	1 套																			
（7）冲击波高频高压发生器	1 套																			
（8）水处理器	1 套																			
（9）病案管理系统（含一键对位超声辅助定位系统）																				



		1 套	
		(10) 压腹带	1 套
		(11) 工具箱	1 套
		(12) 硅胶水囊	3 个
		(13) 彩色多普勒超声诊断仪（含一把凸阵探头、一把线阵双平面探头）	1 套

核心产品：冲击波治疗仪

LXZC11320250189009



第六包:

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	高频手术设备	▲一、适用范围: 适用于在腹腔镜或开方手术中对人体组织进行切割与凝血, 在生理盐水环境下通过等离子技术对组织进行切割与凝血。 二、高频手术设备(主机系统): 1、工作频率: $\geq 300\text{KHz}$; ▲2、工作模式:至少包含 单极切凝模式、双极切凝模式、单双混合切凝模式、双极等离子切凝模式四种; ▲3、各种模式输出功率: 3.1 单极切割模式: 额定负载 150Ω、额定功率$\geq 260\text{W}$; 3.2 单极凝血模式: 额定负载 100Ω、额定功率$\geq 250\text{W}$; 3.3 双极切割模式: 额定负载 150Ω、额定功率$\geq 200\text{W}$; 3.4 双极凝血模式: 额定负载 50Ω、额定功率$\geq 150\text{W}$; 3.5 单双混合切割模式: 额定负载 150Ω、额定功率$\geq 260\text{W}$; 3.6 单双混合凝血模式: 额定负载 50Ω; 额定功率$\geq 150\text{W}$; 3.7 双极等离子切割模式: 额定负载 150Ω、额定功率$\geq 200\text{W}$; 3.8 双极等离子凝血模式: 额定负载 50Ω、额定功率$\geq 150\text{W}$; 4、主机多界面可显示: 负极板贴合状态、双极及等离子模式下的阻抗、电极插入状态和各个模式下的相关参数及设备音量大小、输出是否超载等信息。 ▲5、设备应具有单极模式、双极模式、双极等离子、单双混合等工作模式, 各模式下档位、功率、限压值及输出占空比均可调节并可显示; 6、设备具有中性电极检测监测电路, 即具有监测负极板插入及负极板阻抗区间功能; 7、设备在双极等离子模式和双极模式下具有输出功率时, 在 $0-2000\Omega$ 范围内, 阻抗条图长度随外阻线性变化而变化, 每变化 1 段最多为 200Ω, 总长最少为 10 段, 并可实时显示。	1	套



	8、设备具有器械识别功能,单极、双极模式、双极等离子模式、单双混合模式等模式插入器械后均能自动设定当前模式的默认档位。 9、具有超负荷保护装置,当遇到过载时屏幕需有错误提示,以保证手术的安全开展。 ▲10、在同一把手术器械上需具备单双混合输出的工作模式,即为切割时为单极模式的快速切割、凝血时自动切换为双极模式的双极电凝,以满足高效、快速组织分离的同时能安全可靠的进行组织凝闭。 11、外形尺寸不得大于 W410xH176xD453 mm, 额定电压 AC 220 V /50 Hz、额定输入功率(功耗) ≤ 600VA。 12、双踏板脚踏开关:双踏板,带转换控制输出模式切换按钮,符合 YY/T 1057-2016 标准。 三、配套刀头: 1、单双混合专用电极:要求满足主机单双混合输出模式,同一把器械切割为单极输出凝血为双极输出的功能。 2、双极电凝电极:双极电凝电极至少满足鸭嘴型和尖嘴型两种形状可选。 ▲四、升级选配: 可选配与主机为同品牌(同一注册人)的电切内窥镜和电切内窥镜配套所需的双极电极(等离子刀头/电切环),以满足主机等离子模式在泌尿外科前列腺电切及妇科宫腔电切等手术的配套需要,电切内窥镜需满足外鞘外径 26Fr 和 23Fr 两种规格可选,双极电极需最少满足 5 种形状 10 个型号可选。 五、电切内窥镜一套(包含如下),可连续进出水冲洗对流。 1.1、内窥镜, 30° 4mm×302mm 高清内窥镜,可高温高压消毒 1.2、被动式操作器,被动式,新型人体工程学被动式工作手柄,前操控手柄可同时四手指抓握,从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜,与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态,可提高操控性,	
--	---	--



		减少操作疲劳 1.3、外鞘，26Fr 设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。 1.4、内鞘，24Fr 可 360° 旋转。 1.5、内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术 1.6、闭孔鞘芯，与内鞘配套使用。 1.7、冲洗接头，与内鞘配套使用。		
--	--	--	--	--

核心产品：高频手术设备

LXZC11320250189009



第七包:

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	可视喉镜	电子支气管镜: 1、视场角$\geq 120^\circ$; 2、工作软管有效长度$\geq 600\text{mm}$; 3、景深 3mm-100mm; 4、插入部外径$\leq 5.2\text{mm}$, 工作通道内径$\geq 2.6\text{mm}$; 5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度: 向上$\geq 180^\circ$, 向下$\geq 130^\circ$; ▲6、操作手柄具备左右旋转功能, 向左$\geq 120^\circ$, 向右$\geq 120^\circ$; 7、前端内置 LED 光源, LED 光源光照度$\geq 1000\text{Lux}$; 8、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式; ▲9、操控部手柄遥控按钮≥ 2 个功能按键, 可进行图像摄录, 图像冻结, 解除冻结, 图像放大等预设功能; 10、洗消方式≥ 2 种, 可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消; 11、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆 4 部分, 经消毒灭菌后可重复使用; 12、标配≥ 3 寸非触摸便携显示器, 分辨率$\geq 9.92 \text{ IP/m}$; ▲13、内置可充电式锂电池, 不可插拔, 电池容量$\geq 2300\text{mAh}$, 工作时间> 120 分钟; 14、内置 $\geq 32\text{G}$ 内存 (不可插拔), 可拍照≥ 40 万张, 或录像≥ 18 个小时; 15、显示器能上下 $0-180^\circ$ 转动, 向左向右能 $0-180^\circ$ 转动, 以方便特殊体位的操作; 16、按电源键 1-3 秒, 完成开机或关机操作。 ▲17、注册证: 电子支气管镜相关注册证, 符合电子支气管镜收费规定;	1	台



	可视软性喉镜： 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容 av 输出、吸痰、给药、吹氧等功能，显示器为专机专用，不可与其他喉镜内设备共用，最大限度保障使用寿命 ▲2、3.0" ±10%TFT 显示屏，非触摸屏，分辨率 9.921p/mm±10%。 ▲3、显示器具备优质的色彩还原能力，能在显示器上分辨标准色板上的至少 6 种颜色 4、显示器能上下 0°~180°转动，左右 0°~180°转动 5、设备成像应清晰，视场边缘清晰，在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病 6、软管直径：5.2mm±10%，内通道≥2.6mm 7、前端蛇骨弯曲角度：向上≥160°，向下≥130°； 8、视场角：90° ±10%，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变； ▲9、LED 光源，光照度 700Lux±10% ▲10、LED 光源在 7mm 处照明光斑应充满视场，视场内无明显的亮暗分界线 ▲11、红外截止性能≤6mw/1m ▲12、可分辨灰阶度≥10 ▲13、景深：3-100mm（固定焦距）； ▲14、插入部需置入人体口腔内部，要求材质：插入管材料为聚氨酯，弯曲部材料为氟橡胶，头端材料为 PEEK 15、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求； 16、具备拍照录像、数据存储功能，标配 8G 内置 TF 卡 17、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；充电器输出：5V DC，1A； ▲18、内置可充电式电池，电池容量≥2300mAH； 19、配备测漏仪自检零件 20、可选配 8 寸外接高清显示屏和台车	1	台
--	--	---	---



	电子鼻咽喉内窥镜： 一、电子鼻咽喉内窥镜 1、视场角$\geq 120^\circ$； ▲2、工作长度$\geq 365\text{mm}$； 3、分辨率：$\geq 9.92\text{Lp/mm}$； ▲4、景深 $3\text{mm}-120\text{mm}$； 5、插入管 4 种规格可选： 外径$\leq 2.8\text{mm}$；工作通道：无 外径$\leq 3.8\text{mm}$；工作通道：无 外径$\leq 4.2\text{mm}$；工作通道：$\geq 2.0\text{mm}$ 外径$\leq 4.5\text{mm}$；工作通道：$\geq 2.2\text{mm}$ 6、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上$\geq 130^\circ$，向下$\geq 130^\circ$； 7、前端内置 LED 光源，LED 光源光照度$\geq 1000\text{Lux}$； ▲8、操控部手柄遥控按钮≤ 2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能； 9、成像原理：全电子 CMOS 成像技术，工作软管内不含导像及导光纤； 10、插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物相容性，内外绝缘，确保手术安全； 11、前端内置 LED 光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察； 12、电子鼻咽喉内窥镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用 PEEK 材料，轻质化设计，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀； 13、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥ 24种颜色； ▲14、洗消方式≥ 2种，自带保护帽，ETO 帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； 15、轻质化镜体：镜体总重量$< 300\text{g}$，镜体轻质材料设计，减少	1	台
--	--	---	---



	临床医生长时间使用的疲劳度； 16、注册证：用于鼻咽喉上呼吸道的观察、诊断和治疗； ▲17、产品使用年限≥ 6年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命。 二、显示部件 1、屏幕≥ 3寸，非触摸式显示器（避免术后洗消问题）； 2、便携显示屏内置可充电式锂电池，不可插拔，电池容量$\geq 2200\text{mAh}$，待机时间> 120分钟 ▲3、便携显示屏内置 $\geq 32\text{G}$ 内存（不可插拔），可拍照≥ 30万张，或录像 ≥ 16个小时； ▲4、显示器上下翻动 180°，左右转动 180°，以方便特殊体位的操作； 5、显示屏带录像显示及电量提示功能，具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识（用于显示充电电量或适配器连接充电提示） 6、开机时间：≤ 3秒 即能实现即插即用的内镜图像使用，提高效率。	
--	---	--

核心产品：电子支气管镜、可视软性喉镜：电子鼻咽喉内窥镜



第八包：

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	血管内超声诊断仪	1、超声诊断平台，支持 $\leq 40\text{MHz}$ 或 $\geq 60\text{MHz}$ 机械旋转式超声导管 2、移动推车式 3、内置高速机械存储硬盘 $\geq 1\text{T}$ ，病人数据存储更可靠 4、 ≥ 19 英寸 1280*1024 高分辨率专业医学显示器 5、配备光电鼠标，通过鼠标进行操作，描绘图像。可以通过鼠标滚轮在不同的 Frame 之间切换 6、系统处理器：搭载高性能 i7 处理器，处理器频率达到 3.6GHz 及以上 7、专业热敏黑白打印机 8、驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。自动回撤，最高回撤速度支持 10mm/s； 9、回撤马达与滑板采用一体化设计，术中无额外耗材费用 10、轴向分辨率 ≤ 22 微米 11、自动回撤模式下，速度响应三档以上（不含三档）可选档速 12、回撤距离 $\geq 150\text{mm}$ 13、自动回撤采集数 ≥ 7800 帧图像 14、手动回撤采集数 ≥ 7800 帧图像 15、可提供图像直接以 Windows 兼容的 AVI 视频输出格式及 PNG 或者 JPG 格式的静态图片 16、与本院 HIS 系统及 PACS 系统实现互联互通 17、具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件，并可根据医生选择的检查血管段进行自动分析及标注需重点关注的信息 18、具有图像动态回顾功能，反复播放图像，具有自动化血管壁和血管内腔测量计算软件 19、具有双图功能：显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像。 20、具备书签添加功能，便于记录并快速查看书签图像。 21、具备自动书签距离测量功能	1	台



		22、具备图像降噪选择模式，可以有效降低图像噪声信号，提高图像分辨率 23、长轴标尺:长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量 24、具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率$\leq 40\text{MHz}$ 或 $\geq 60\text{MHz}$ 25、超声导管长度$\geq 110\text{cm}$ 26、搭配 0.014 导丝使用，兼容 6F 指引导管 27、导管具有亲水涂层		
--	--	--	--	--

核心产品：血管内超声诊断仪

LXZC11320250189009



第九包：

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	低速冷冻离心机	1. 性能要求：富血小板血浆 PRP 制备专用，使用一次性无菌注射器制备多形态制品，制备过程中无需其他专用耗材。 ▲2. 软件控制系统： 2.1 设备内置安卓智能数据管理系统，收集记录患者样本数据及制备数据，数据通过蓝牙链接同步显示在安卓手机终端。系统可升级扩展。 2.2 系统预设制备程序，智能计数；每运行 100 次参数自动校准，免手动设置。 2.3 系统自定义程序，转速离心力自动换算、同屏显示。 ▲3. 制备容器： 3.1 采用 10ml 规格一次性使用无菌注射器制备，注射器无需剪切改装、无预装药液。 3.2 最大样本容量 40ml，最小样本容量 10ml。 ▲4. 适配器： 4.1 水平式转子，匹配特制适配器，内部盛放正向放置的原装注射器。 4.2 适配器内部结构设计于注射器吻合，防爆分压，防漏液。 4.3 适配器可拆卸、更换，免称重配平。 4.4 适配器材质可高温高压灭菌，反复使用。 ▲5. 离心程序： 5.1 预设 PRP 制备模块并按≥ 3个病种设置个体处方制备程序，每个处方离心次数不同。 5.2 医生可根据临床需求制备不同血小板、白细胞计数的制品（3-5 倍浓度 P-PRP/L-PRP）。 5.3 预设 PRF 制备模块、CGF 制备模块，利用注射器制备，无需外源性物质。制备时间 5~15 分钟。 5.4 所有制品最终性状可呈液态或凝胶状，并配备相应制备配件。	1	台



		▲6. 具有制冷系统，温度控制范围$\leq 20^{\circ}\text{C}$，温度控制精度$\pm 2^{\circ}\text{C}$。 7. 内置紫外线消毒装置。 8. 具有减震平衡系统，振幅< 0.08。 9. 10 英寸彩色触摸屏，智能进度提示，实时状态监视。 10. 最高转速：$\leq 5000\text{r/min}$。 11. 转速控制精度：$\pm 50\text{r/min}$。 12. 噪音：$\leq 70\text{dB}$。		
--	--	--	--	--

核心产品：低速冷冻离心机

LXZC11320250189009



4.2 交付要求:

4.2.1 交付时间:

第一、二包: 自合同签订之日起90日内完成交货、安装至验收合格。

第三、四、五、六、七、八、九包: 自合同签订之日起30日内完成交货、安装至验收合格。

4.2.2. 交付地点: 临夏县人民医院指定地点

4.3 履约保证金: /

4.4 售前服务要求:

4.4.1 要求向采购人和直接使用人提供所需产品的使用要求等。

4.4.2 安装过程中积极配合采购人和维修工程师共同参与产品的验收、安装。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用指导。

4.5 售后服务

4.5.1 设备保修期要求至少为一年。在保修期内接到货物发生故障的通报,要求在2个小时内做出响应,在24个小时内赶到,保证设备正常使用。

4.5.2 包退包换要求: 质保期内,无法修复的设备,需替换同样设备供客户使用,直至故障设备修复。

4.5.3 质保期内上门服务要求: 保修期内,所有设备维护保养服务均为上门服务,由此产生的费用均不再收取。免费提供系统升级方面的技术支持服务。

4.5.4 要求定期派遣责任工程师巡访客户,做一些日常维护工作,并与直接使用人交流货物使用相关事宜。

4.5.5 双方协商保修期过后的维修方式,中标方尽最大力度支持用户自身的维护,以减轻用户的负担。

4.5.6 人员培训要求: 对操作人员进行维护和保养培训。



第五章、评标原则及办法

5.1 评标工作中的原则及组织

5.1.1 评标原则

(1) 评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(3) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.1.2 组织

1) 评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审查评价和技术部分审查评价。

2) 代理机构：由甘肃合岳工程项目管理有限责任公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3) 审核小组：由评标委员会主任委员和采购人代表共同组成，负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表进行统计审核，并汇总计算总分。

5.2 评标程序

5.2.1 投标文件的初审

评标委员会依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初步审核，了解其对招标文件是否作出了实质性的响应。如果投标人的投标文件未通过初步审核，评



委会拒绝对其作进一步的评审。

1) 资格性审查

采购人或代理机构根据投标须知一览表资格要求依法对投标人的资格进行审查。

2) 符合性审查

投标文件属于下列情况的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不能满足招标文件中任何一条实质性要求或投标内容不符合相关强制性规定的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 经评审委员会认定，投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

评标委员会将审查投标人提供的资格证明文件，投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

- (1) 在网上开评标系统提交的开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以网上开评标系统中提交的开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。



评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.2.2 投标文件的澄清

澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照代理机构通知的时间指派投标代表人就相关问题进行澄清。

投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

5.2.3 投标的评价和比较：评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标采用综合评分法进行评价和比较。即对初审合格的投标文件中所载入的投标设备技术参数、技术性能、采用标准、质量保证措施、技术资料，以及合理的投标报价、相近业绩、质保年限、售后服务、交货期、投标文件完整性等内容等条款进行综合记分、择优选择。

5.2.4 推荐中标候选人名单。

中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.2.5 编写评标报告及其他事项情况说明（如有）。

5.3 评标方法(第一包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。



因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标价 = 总投标报价 - 总投标报价 × 10%

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

具体评分标准如下：

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（价格权值为 30）× 100%。	30 分
商务部分 (7 分)	商务条款响应	付款方式、交货期、交货地点、质保期，培训等， 全部响应得 5 分，一项不响应扣 1 分，均不响应不得分。 (满分 5 分)	5 分
	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 2 分。不提供不得分。	2 分
技术部分 (63 分)	技术参数响应	产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人需提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料可视为不满足，“▲”条款不符合每条扣 3 分，普通参数每条不符合扣 2 分，扣完为止。 注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，被视为负偏离进行扣分。 (证明材料包括产品检验报告或产品合格证，及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的，视为不满足技术参数要求。)	25 分



	实施方案	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②人员配置③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	培训方案	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划包括①培训方案②培训时间③培训课程④培训计划安排⑤培训制度等；以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保证措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8 分



	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任何一种情形。	10 分
--	--------	--	------

LXZC113202501890009



评标方法(第二包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标价 = 总投标报价 - 总投标报价 × 10%

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

具体评分标准如下：

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（价格权值为 30）× 100%。	30 分
商务部分 (7 分)	商务条款响应	付款方式、交货期、交货地点、质保期，培训等， 全部响应得 5 分，一项 不响应扣 1 分，均不响应不得分。 (满分 5 分)	5 分
	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 2 分。不提供不得分。	2 分



技术部分 (63分)	技术参数响应	产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人需提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料可视为不满足，“▲”条款不符合每条扣3分，普通参数每条不符合扣2分，扣完为止。 注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，被视为负偏离进行扣分。（证明材料包括产品检验报告或产品合格证，及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的，视为不满足技术参数要求。）	25分
	实施方案	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②人员配置③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上5项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得10分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不满足的扣1分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10分
	培训方案	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划包括①培训方案②培训时间③培训课程④培训计划安排⑤培训制度等；以上5项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得10分；每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不满足的扣1分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10分



	保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保障措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8 分
	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分



评标方法(第三包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标价=总投标报价—总投标报价×10%

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

具体评分标准如下：

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值(价格权值为 30) × 100%。	30 分
商务部分 (4 分)	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 2 分，共计 4 分。不提供不得分。	4 分
技术部分 (66 分)	技术参数响应	产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人需提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料可视为不满足，“▲”条款不符合每条扣 3 分，普通参数每条不符合扣 2 分，扣完为止。 注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，被视为负偏离进行	40 分



		扣分。（证明材料包括产品检验报告或产品合格证，及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的，视为不满足技术参数要求。）	
	实施方案	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②人员配置③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	技术方案	投标人技术方案具有行业先进性，方案综合考虑建设方需求，整体方案架构合理。方案包括①所投产品的系统架构②功能模块③技术路线等；以上 3 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 3 分，每缺少一项内容扣 1 分，每有一项内容不满足的扣 0.5 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	3 分



	保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保障措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上4项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不满足的扣1分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8分
	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上5项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得5分，每缺少一项内容扣1分，每有一项内容不满足的扣0.5分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	5分



评标方法(第四包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（价格权值为 30）× 100%。	30 分
商务部分 (7 分)	商务条款响应	付款方式、交货期、交货地点、质保期，培训等， 全部响应得 5 分，一项 不响应扣 1 分，均不响应不得分。 (满分 5 分)	5 分
	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 2 分。不提供不得分。	2 分
技术部分 (63 分)	技术参数响应	产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人需提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明材料可视为不满足，“▲”条款不符合每条扣 3 分，普通参数每条不符合扣 2 分，扣完为止。 注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，被视为负偏离进行扣分。（证明材料包括产品检验报告或产品合格证，及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的，视为不满足技术参数要求。）	25 分



	实施方案	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②人员配置③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	培训方案	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划包括①培训方案②培训时间③培训课程④培训计划安排⑤培训制度等；以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保证措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8 分



	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
--	--------	---	------

LXZC11320250189009



评标方法(第五包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合评分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（价格权值为 30）× 100%。	30 分
商务部分 (2 分)	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 2 分。不提供不得分。	2 分
技术部分 (68 分)	技术参数响应	产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人需提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料可视为不满足，“▲”条款不符合每条扣 3 分，普通参数每条不符合扣 2 分，扣完为止。 注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，被视为负偏离进行扣分。 (证明材料包括产品检验报告或产品合格证，及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的，视为不满足技术参数要求。)	30 分



	实施方案	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②人员配置③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	培训方案	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划包括①培训方案②培训时间③培训课程④培训计划安排⑤培训制度等；以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保证措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8 分



	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
--	--------	--	------

LXZC11320250189009



评标方法(第六包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合评分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 (价格权值为 30) × 100%。	30 分
商务部分 (7 分)	商务条款响应	付款方式、交货期、交货地点、质保期，培训等， 全部响应得 5 分，一项 不响应扣 1 分，均不响应不得分。 (满分 5 分)	5 分
	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 2 分。不提供不得分。	2 分
技术部分 (63 分)	技术参数响应	产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人需提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料可视为不满足，“▲”条款不符合每条扣 3 分，普通参数每条不符合扣 2 分，扣完为止。 注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，被视为负偏离进行扣分。 (证明材料包括产品检验报告或产品合格证，及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的，视为不满足技术参数要求。)	25 分
	实施方	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计	10 分



	案	划②人员配置③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	
	培训方案	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划包括①培训方案②培训时间③培训课程④培训计划安排⑤培训制度等；以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保障措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8 分



	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
--	--------	---	------

LXZC11320250189009



评标方法(第七包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（价格权值为 30）× 100%。	30 分
商务部分 (7 分)	商务条款响应	付款方式、交货期、交货地点、质保期，培训等，全部响应得 5 分，一项不响应扣 1 分，均不响应不得分。（满分 5 分）	5 分
	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 2 分。不提供不得分。	2 分
技术部分 (63 分)	技术参数响应	产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人需提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料可视为不满足，“▲”条款不符合每条扣 3 分，普通参数每条不符合扣 2 分，扣完为止。 注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，被视为负偏离进行扣分。（证明材料包括产品检验报告或产品合格证，及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的，视为不满足技术参数要求。）	25 分



实施方案	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②人员配置③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
培训方案	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划包括①培训方案②培训时间③培训课程④培训计划安排⑤培训制度等；以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保证措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8 分



	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任何一种情形。	10 分
--	--------	---	------

LXZC11320250189009



评标方法(第八包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合评分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值(价格权值为30)×100%。	30 分
商务部分 (7 分)	商务条款响应	付款方式、交货期、交货地点、质保期, 培训等, 全部响应得 5 分, 一项 不响应扣 1 分, 均不响应不得分。(满分 5 分)	5 分
	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明,需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章,每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分, 共计 2 分。不提供不得分。	2 分
技术部分 (63 分)	技术参数响应	投标人需提供满足技术参数要求的证明资料,未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明材料可视为不满足, 参数每条不符合扣 2 分, 扣完为止。 注: 投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料, 若未按照要求提供或提供不全, 被视为负偏离进行扣分。(证明材料包括产品检验报告或产品合格证, 及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的, 视为不满足技术参数要求。)	25 分



	实施方案	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②人员配置③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	培训方案	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划包括①培训方案②培训时间③培训课程④培训计划安排⑤培训制度等；以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分



	保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保障措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8 分
	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分



评标方法(第九包)

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

评审项目	评审因素	评分细则	明细分值
报价评审	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值（价格权值为 30）× 100%。	30 分
商务部分 (7 分)	商务条款响应	付款方式、交货期、交货地点、质保期，培训等， 全部响应得 5 分，一项不响应扣 1 分，均不响应不得分。 (满分 5 分)	5 分
	业绩	投标人提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书或合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 2 分。不提供不得分。	2 分
技术部分 (63 分)	技术参数响应	产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人需提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料可视为不满足，“▲”条款不符合每条扣 3 分，普通参数每条不符合扣 2 分，扣完为止。 注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，被视为负偏离进行扣分。（证明材料包括产品检验报告或产品合格证，及产品说明书等。提供了技术支持证明材料但与技术参数要求内容不符的，视为不满足技术参数要求。）	25 分



	实施方案	根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②供货方案③包装、运输方案④安装、调试方案⑤验收方案等；能确保项目供货阶段工作有效进行，保证货物按期按质按量供应到位，以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	培训方案	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划包括①培训方案②培训时间③培训课程④培训计划安排⑤培训制度等；以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分；每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
	保障方案	根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保证措施②维修承诺③应急预案④安全保障措施；以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	8 分



	售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①响应时间及故障排除时间②保修计划③售后服务体系流程④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1 分，扣完为止。注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。	10 分
--	--------	--	------

注：投标货物属于《临夏州州级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准》中通用办公设备和办公家具的，投标报价不得超出《临夏州州级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准》的价格上限，否则作无效投标处理。

5.5 中标供应商的确定

评标委员会完成评标后，应当提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

若第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，须补偿由此给采购人带来的损失后（即补齐与第二中标候选人之间的投标报价差额，并将按相关规定追究其法律责任），采购人可以按照中标候选人名单排序确定下一候选人为中标人，依次类推。投标人得分出现绝对相等时，以低价优先的原则确定中标人。

中标人确定后，由采购人公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，并在中标通知书发出之日起 10 日内与中标人签订书面合同。



资格证明文件

1. 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）
2. 财务状况：投标人提供投标截止日前 18 个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或投标截止日前近两个月内银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）
3. 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的 12 个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）
4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前 12 个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件)
5. 无重大违法记录声明参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件彩色扫描件)。（截至开标日成立不足 3 年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明(原件彩色扫描件)或法定代表人授权书(原件彩色扫描件)
7. 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站([www .creditchina. gov .cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网([www. ccgp. gov .cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。（投标人无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）
- 8、本项目的特定资格要求：供应商必须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类



医疗器械经营备案凭证》（原件彩色扫描件加盖本单位公章）

9、投标人须为在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。（适用于第四、五、六、七、八、九包）

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

说明：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. 本章中“投标截止日前”是指以投标截止日为起始时间倒推每一项相应要求的时间。



附件 1:采购合同格式

临夏县人民医院医疗设备采购项目

购 销 合 同

合同编号: LXZC

需 方:

供 方:

年 月 日



临夏县人民医院医疗设备采购项目 购销合同

根据“临夏县人民医院医疗设备采购项目【招标文件编号：_____】
的招标结果，_____（以下简称需方）与_____（以下简
称供方）签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、草拟时间：_____年_____月_____日

四、合同内容：根据《中华人民共和国民法典》及【招标文件编号：_____】
投标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：_____（¥_____元）

七、中标供应商需向招标人在签订协议后，以非现金形式缴纳中标合同价的3%，作为履约保证金。待项目验收合格后，中标供应商若无不良记录或安全事故，招标人及时无息退还。

八、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、付款方式：

（1）本合同签订后支付30%的预付款。

（2）卖方按合同规定交货，货到现场，经买方核对品牌、型号、数量无误后，凭验货物交接单及按合同总价开具的发票，由采购人支40%的合同货款。



(3) 所有设备经买方(使用单位)验收合格后,凭验收合格证明后支付剩30%货款。

5、供需双方签订的合同,应在政府采购监管部门的监督下认真履行。

6、违约责任:供方应依据合同规定时间按时交货,如不能,由此给需方带来的损失由供方负责。

7、质量验收:

(1) 到货后需方组织专人进行验收,验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样,逾期验收视为验收合格。

(2) 需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时,应及时通知供方,供方应在接到通知后三天内给予答复,并负责处理,若需送法定质检部门检验,检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的,需方可通知供方停止供货,解除合同。

(3) 供方中标后货物调整的数量必须控制在合同金额的10%以内,如不符合要求的,需方可通知供方停止供货,解除合同。

九、交货时间、交货地点和验收单位:

1、交货时间:

第一、二包:自合同签订之日起90日内完成交货、安装至验收合格。

第三、四、五、六、七、八、九包:自合同签订之日起30日内完成交货、安装至验收合格。

2、交货地点:临夏县人民医院指定的交货地点

3、验收单位:临夏县人民医院

十、经济责任:

(一) 供方责任

(1) 供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的,需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物,供方须向需方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时,需方同意利用的按质论价,不能利用的,供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的,每延误一日,供应方应按逾期交货部分货物价款总值的5%向需方偿付违约金。

(3) 供方必须按合同规定的日期交货,每逾期一日,供方必须向需方支付



逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

（二）、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

十一、合同解释：

如合同条文存在歧义，《民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十二、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国民法典》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十四、本合同一式肆份，经供需双方签字盖章后生效，需方壹份，供方壹份，临夏县财政局采购办备案壹份，甘肃合岳工程项目管理有限责任公司采购代理机构备案壹份，均具有同等法律效力。



此页无正文

供方：（章） 地址： 电话： 邮编：	需方：（章） 地址： 电话： 邮编：
法定代表人： 经办人： 签字日期：	法定代表人： 经办人： 签字日期：
代理机构： 负责人： 签字日期：	

LXZC11320250189009



附件2:

投标函

致:临夏县人民医院

根据已收到的招标编号为 LXZC11320250189 的临夏县人民医院医疗设备采购项目公开招标采购招标文件, 我单位经认真研究上述招标文件, 决定参加本次投标。

- 1、我方提交电子版投标文件壹份并保证其真实性。
- 2、我方完全接受招标文件的内容, 并将按采购文件的规定履行责任、义务。
- 3、我方已详细审查全部招标文件, 包括修改文件、参考资料及有关附件, 无其他不明事项。
- 4、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
- 5、我方同意所递交的响应文件在 90 天的投标有效期内有效, 在此期间我方将受此约束。
- 6、如我方中标:
 - (1) 我方承诺在收到《中标通知书》后, 在《中标通知书》规定的期限内与你方签订合同。
 - (2) 我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金、支付招标代理服务费。
 - (3) 我方承诺按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。
 - (4) 我方承诺“按照合同约定的产品或服务进行交付, 保证业务交易的真实性, 不进行私下交易、同下单人进行虚假交货、变通、返现等。”

我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在招标文件规定的任何一种情形。如有弄虚作假, 将承担相应的法律责任, 并赔偿由此造成的一切损失。

单位公章:

法定代表人或被授权人(签字或印章):

通讯地址:

邮政编码:

联系电话:

传 真:

日 期: 年 月 日



附件 3:

法定代表人身份证明

投标人名称:

注册号:

注册地址:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

姓名: 性别: 年龄: 系 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证原件扫描件
(正反面加盖公章)

投标人名称 (盖章):

法定代表人 (签字):

日期: 年 月 日

注: 关于分公司投标 (除石油石化、电力、通信、银行、金融、保险等特殊行业外, 本项目不接受非独立法人单位分公司的投标) 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的, 只需提供分公司企业负责人身份证明及身份证



附件 4:

法人授权函

致:临夏县人民医院

本授权函声明: _____ 任命 _____ 为我公司的授权代表人, 参与招标编号为 _____ 的 _____ 项目的投标活动, 以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人身份证原件扫描件

(正反面加盖公章)

委托代理人身份证原件扫描件

(正反面加盖公章)

投标人名称 (盖章):

法定代表人 (签字或印章):

被授权人 (签字或印章):

授权日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 关于分公司投标 (除石油石化、电力、通信、银行、金融、保险等特殊行业外, 本项目不接受非独立法人单位分公司的投标) 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的, 只须提供分公司企业负责人身份证明及身份证



附件 5:

投标报价明细表

项目名称：临夏县人民医院医疗设备采购项目

项目编号：LXZC11320250189

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价 (元)	总价(元)	备注
投标总价合计		(大写)： (小写)：						

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

说明：1. 投标货物属于《临夏州州级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准》中的通用办公设备和办公家具的，投标报价不得超出《临夏州州级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准》的价格上限，否则作无效投标处理。

2. 品牌和制造厂商指投标产品的品牌和生产厂商，如供应商不明确填写“货物名称、规格型号、制造厂家、数量”的详细内容，只填写“详见投标文件”或类似字样，视为无效投标。

3. 本表中的投标总价应与固化的“开标一览表”中的投标总价金额相一致，如不一致以固化的“开标一览表”为准。



附件 6:

投标人基本情况

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
企业性质					
法定代表人		技术职称		电话	
技术负责人		技术职称		电话	
营业执照号				员工总人数:	
注册资金				高级职称人员	
开户银行				中级职称人员	
账号				初级职称人员	
成立时间				技工	
经营范围					
备注					

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

投标日期： 年 月 日



附件 7:

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证件名称	级别	证号	专业
管理 人员								
技术 人员								
售后 服务 人员								

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

投标日期： 年 月 日



附件 8:

产品质量保证与服务承诺函

致:临夏县人民医院

关于贵方2025年 月 日就临夏县人民医院医疗设备采购项目公开招标（招标文件编号：LXZC11320250189）事宜，我公司作为投标人，作如下保证：

1. 交货期：
2. 质保期：
3. 产品质量承诺：
4. 售后服务承诺：
5. 技术培训承诺：
6. 包退包换承诺：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日



附件 9:

近三年已完成类似项目一览表

序号	项目名称	项目内容 (类似项目)	合同金额 (万元)	已结算金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话	相关证明材料 所在页码
1							
2							
3							
4							
5							
...							

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

日期：年 月 日

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应提供收到的中标通知书或双方签订的合同或已签发的最终验收证书。



附件 10:

投标货物偏离表

项目名称：临夏县人民医院医疗设备采购项目

项目编号：LXZC11320250189

品目号	货物名称	品牌	型号规格	招标文件要求参数	投标货物实际参数	偏离情况	技术支撑材料所在页码

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

说明：①“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

②请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“第四章”中的采购需求认真填写该表。该表不能作为所投产品的技术文件，投标供应商应在投标文件中单独提供技术文件。

③投标供应商不能简单复制招标文件的技术参数条款作为投标技术参数的应答，应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中可以不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术参数作为投标参数的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标委员会**有权判定该投标为无效投标**。同时，未提供或未能有效提供所投产品的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标人自负。

④“技术支撑材料所在页码”系指投标供应商提供的证明材料类型、证明材料与技术参数相对应的页码及条款号。如：检测报告第 x 页第 x 项。不按要求填写“证明材料说明”或提供虚假材料的，评标委员会**有权判定该投标为无效投标**。



附件 11:

没有重大违法记录的书面声明书

致：临夏县人民医院

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日



附件 12:

投标单位承诺书

致：临夏县人民医院

我公司认真阅读了_____项目招标文件的内容后，
决定参加该项目的投标，现承诺如下：

- 1、自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》及《政府采购法》等相关法律法规和规章制度。
 - 2、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
 - 3、所提供的一切材料真实、有效、合法。
 - 4、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。
 - 5、不搞围标、串标，不排挤、损害其他投标人利益。
 - 6、不与采购人、招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益和其他人的合法利益。
 - 7、不向采购人、招标代理机构或评标委员会成员行贿以谋取中标。
 - 10、保证中标后严格履行合同，绝不分包、转包他人。
- 本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格（中标资格），记入信用档案等相关处理，愿意承担相关法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日



附件 13:

同意招标文件条款声明

致：临夏县人民医院

为响应你方组织的_____采购项目的货物及服务的招标采购，项目编号为：_____，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日



附件 14:

虚假应标承担责任声明

致：临夏县人民医院

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格等决定。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日



附件 15:

联合体协议（如有）

致（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式 份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

成员二名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

说明：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。



附件 16:

政府采购政策情况表

项目名称:

招标文件编号:

包号:

单位: 元

中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： () 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 () 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：				
	产品名称	品牌型号	制造商	制造商企业类型	金额
	小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品金额合计				
监狱企业	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。				
残疾人福利性单位	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 该声明函见投标文件第 至 页。				

- 填报要求：
1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《报价明细表》一致。
 2. “制造商企业类型”栏填写内容为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
 3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
 4. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指投标人及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。



中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法 财库(2020)46号》的规定,本公司(联合体)参加_____(单位名称)的_____(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____(标的名称), 属于_____(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为_____(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元¹, 属于_____(中型企业、小型企业、微型企业);

2. _____(标的名称), 属于_____(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为_____(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于_____(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。



（单位名称）××年面向中小企业预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
.....				

部门（单位）名称：

日期：



残疾人福利性单位声明函（投标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

注：提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供该残疾人福利性单位的声明函。

LXZC11320250189009



残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（单位公章）：

日期： 年 月 日

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品, 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。
2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品, 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。
3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



政府采购促进中小企业发展管理办法 财库〔2020〕46号

政府采购促进中小企业发展管理办法 财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。



第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；



(二) 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。



第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。



第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中



《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：

1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告



关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。



财 政 部

2022 年 5 月 30 日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。



中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日



附件 17:

“网上开标系统” 投标供应商用户手册

甘肃中工投标文件制作工具操作说明

一、环境要求与相关软件安装配置

1.1 环境要求

操作系统: windows 7/8/10/11
RAM: 4G 以上
基于 IE8 以上的 IE 浏览器, 最好为IE11
能够正常联网的网络环境

1.2 投标软件下载与安装

(若已完成相关软件安装可以跳过此部分, 直接看操作手册)

步骤:

1. 打开 甘肃中工官网




2. 使用者需要从【中工首页】-【下载中心】-【新版工具】找到“投标工具”进行下载



该投标工具为捆绑组件包, 只需安装此捆绑便拥有: 投标标书制作软件、电子签章插件、标书查看工具以及相关驱动。

3. 安装

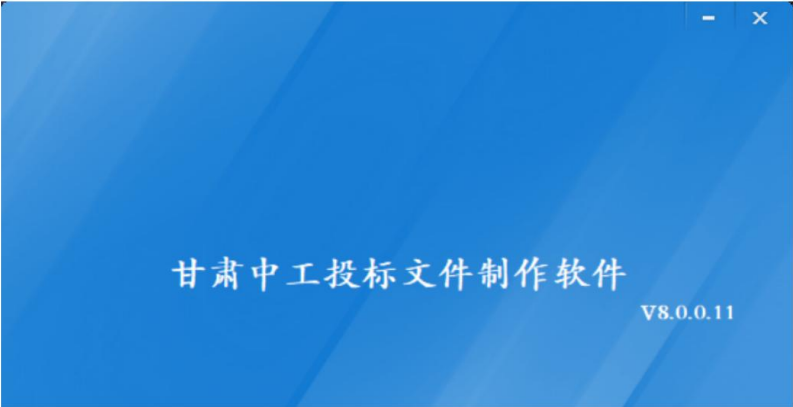

快速安装

☒ 我已阅读并同意 软件许可协议

[自定义安装>>](#)

勾选同意软件许可协议后即可进行快速安装，快速安装默认安装 C 盘。熟悉电脑的用户也可根据自身电脑情况进行自定义安装。



加载相关组件....



点击快速安装后即开始安装，请耐心等待。



当显示如上界面时表示安装已经完成。

二、操作手册

2.1 菜单栏功能介绍

2.1.1 文件



文件菜单功能主要有7个功能：

- 【新建】：用于在电脑本机新建工程项目。
- 【打开】：打开电脑本机上已存在的工程项目。
- 【另存为】：将当前工程项目存到电脑的其他地址。
- 【保存工程】：保存当前工程项目文件。
- 【关闭工程】：关闭当前工程项目。
- 【最近打开的工程文件】：用于快捷打开最近使用工具打开过的工程文件。
- 【退出】：退出。


2.1.2 编辑

编辑菜单主要有两个功能：



- 查看PDF：用于查看当前项目已生成的PDF文档。
- 更新模板：暂不对投标人开放的功能，不作介绍。

2.1.3 导出



导出菜单主要可导出以下两种文件：

- 招标相关文件
- 答疑相关文件


2.1.4 浏览



浏览菜单会调用文件查看工具，该工具可对四种不同类型文件——招标文件、答疑澄清文件、控制价文件、投标文件进行单独查看。



2.1.5 辅助



辅助菜单主要有一下两种功能：

- 获取备份文件：获取制作过程中系统自动备份的文档
- 备份设置：相关备份设置

2.1.6 系统



系统菜单主要有一下两种功能：

- 在线更新：用于检查软件是否为最新，若不是则进行更新升级。
- 环境监测：用于检测软件环境需要的相关驱动和插件是否齐备。

2.1.7 关于和退出

- 关于：用于查看软件信息



- 退出：退出软件





2.1.8 快捷功能栏



- 【新建工程】：新建工程项目文件。
- 【打开工程】：打开电脑本机上已存在的工程项目。
- 【获取备份】：获取制作过程中系统自动备份的文档。
- 【保存工程】：保存工程文件。
- 【系统登录】：点击跳转至开标大厅。
- 【投标文件对比】：用于对两份投标文件的内容进行对比。



第一份文件：

第二份文件：

注：对比结果仅供参考



2.2 投标文件制作操作

2.2.1 功能说明

这里主要介绍投标文件的制作。

2.2.2 前置流程

投标人已经获取对应的招标文件

2.2.3 操作步骤

1. 新建项目。点击快捷功能栏的【新建工程】如下图：





2. 选择待制作投标文件对应的招标文件，选取后会默认自动填充**投标工程文件**栏的名称和路径，可根据需要自行更改。



创建工程

选择标/项目文件


创建工程文件

名称：

路径：

确定 取消

3. 招标文件预览。导入成功后可在【浏览招标文件】浏览**招标文件**基本信息和**招标文件正文**。

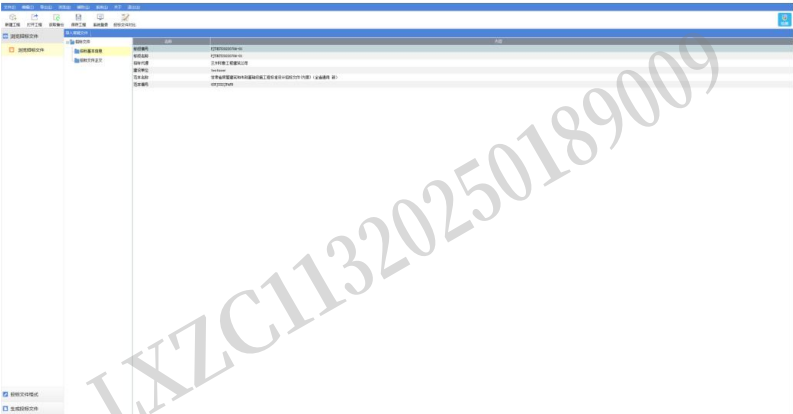

4. 投标文件编制。投标人在【投标文件格式】处对投标文件的具体内容进行编制填写。【投标文件格式】下要求的内容源于招标方的招标文件中的设置，根据不同行业的不同范本内容不同。






5. 投标文件生成。


a. 文件格式转换。

投标文件内容编制完成后，点击【生成投标文件】进入入下图所示文件格式转换界面。点击橙色的【批量转换】按钮可开始一键转换此功能用于将模板内置的Word格式文件转换为PDF格式，若在制作过程中使用者全部导入PDF则【是否已转换】会提示是，则无需转换。

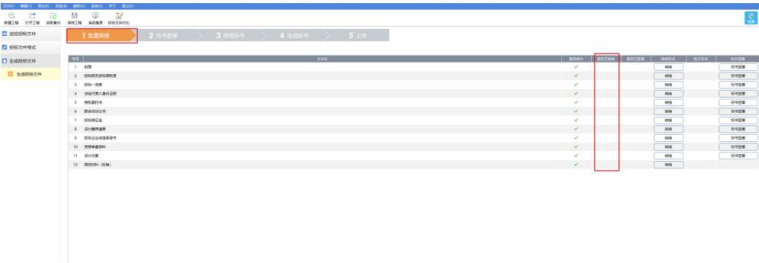

b. 标书签章。

点击PDF工具中的【电子签章】即可使用CA锁对标书内容进行电子签章。

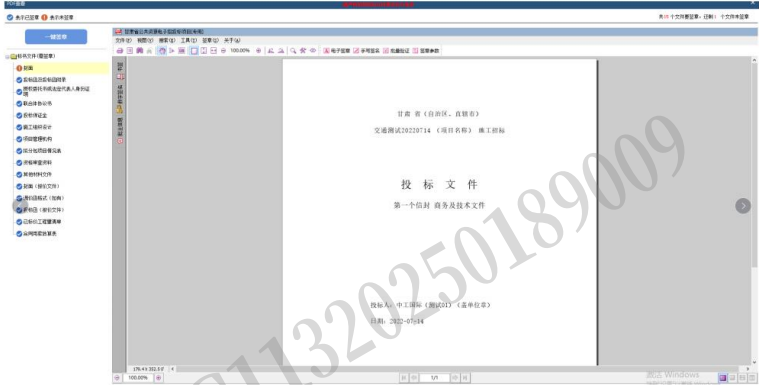

c. 标书预览。

在签章完成后点击【标书预览】可预览整个标书（PDF预览）。



d. 生成标书。

确认标书内容无误后，点击【生成标书】，生成过程中会使用CA锁信息对投标标书内容进行加密，加密后生成两份文件，一份为非加密文件，一份为加密后的文件。加密文件需在开标系统中用相同的CA锁进行解密。



不见面开标大厅使用手册

一、系统简介与环境说明

1.1 系统简介

甘肃中工不见面开标大厅主要是用于线上开标，减少投标人的出差成本；系统包含**开标直播**、**在线解密**、**多标段同时开标**等功能，只要有稳定网络的地方，登录不见面开标大厅就可以实现网上开标，有效的提高工作效率。

系统地址：[不见面开标大厅](#)

1.2 环境要求

操作系统：windows 7/8/10/11

RAM: 4G 以上

基于 IE8 以上的 IE 浏览器，最好为IE11

能够正常联网的网络环境

1.3 投标软件下载与安装

(若已完成相关软件安装和配置可以跳过此部分，直接看操作手册)

参考下面环境配置文档的“IE浏览器设置”及“直播工具”部分。


[环境配置说明文档](#)

二、操作手册


2.1 招标代理角色

2.1.1 登录

代理人打开开标大厅首页，点击【登录】，选择【招标代理】角色进行登录。登录方式可以选择账号密码直接登录也可选择CA登录。

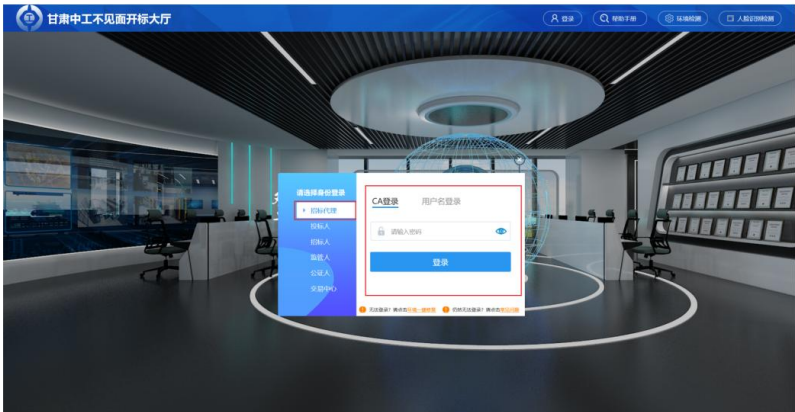


登录成功后进入开标项目页面。项目面板中【我的项目】会展示代理人所拥有的且今日开标的项目内容。也可打开历史项目查看历史项目。页面右上角会显示当前登录的代理账号名称。

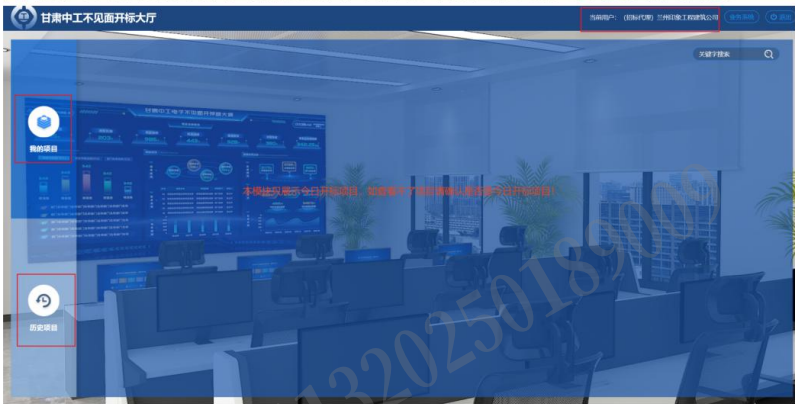

2.1.2 准备阶段

在开标项目页面，点击【我的项目】查看今日开标项目，选择需要的开标项目，点击进入网上开标大厅。

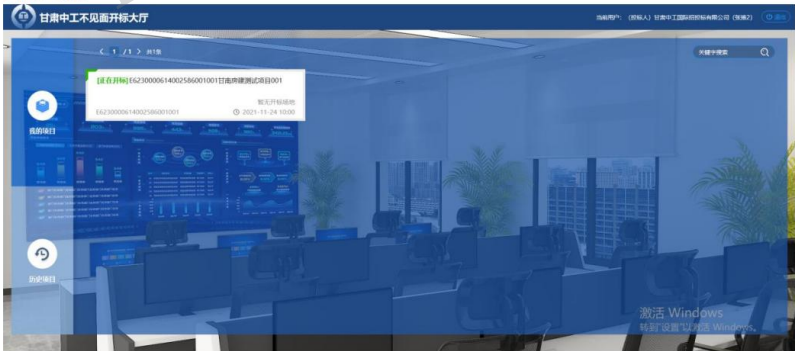


1. 人员信息准备

进入开标大厅界面后输入主持人、招标人、监标人，交易中心工作人员，输入完成后点击【确认】。



在会人员信息完善后，点击【到会人员签到表】显示签到页面。根据投标人签到情况显示投标人是否在席。若是线下开标则可动新增签到信息。

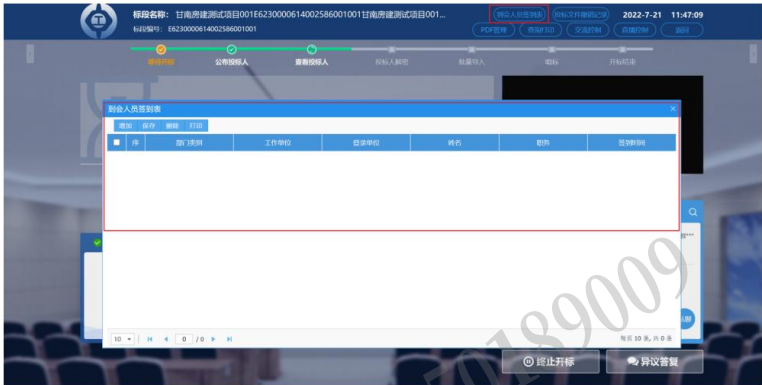

2. 直播准备

我们可以看到开标页面会存在一个黑色的直播显示区域。若需要直播开标现场可点击右上角的【直播控制】如下图：



点击完成后会显示三个新按钮，分别是：【开启直播】、【分享屏幕】和【开启摄像头】。我们需要先点击【开启直播】，开启后控件会自动触发分享屏幕若未能自动开启分享，可手动点击【分享屏幕】。直播摄像头可根据开标需要点击【开启摄像头】进行开启。



直播开启后点击【关闭直播】可以随时关闭当前直播分享。

2.1.3 公布投标人

所有投标单位在席后，招标代理点击公布投标人，显示所有投标人内容，页面显示如下：




2.1.4 查看投标人

该模块可查看投标人情况，存在【图标显示】和【列表显示】。点击对应按钮即可查看对应方式的投标人陈列。




2.1.5 投标人解密

代理点击【下一阶段】后，开启解密环节，投标人进行文件解密。如下图：

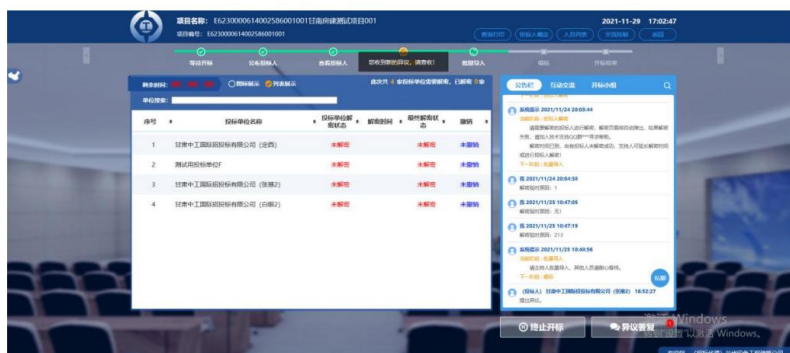

解密阶段: 设置好招标文件约定的解密时长, 点击【解密】进行设置。

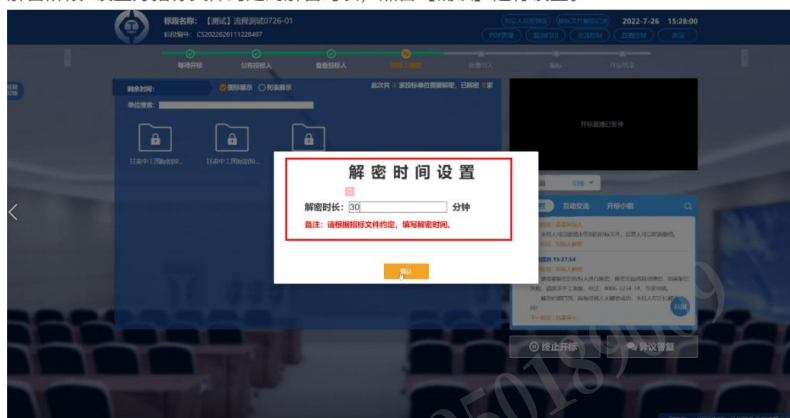

若解密时长到了, 解密还没结束可以进行解密延时 (一般不启用, 只要在特殊情况时需要进行时)。

2.1.6 批量导入

所有投标单位解密完成后, 招标代理点击【批量导入】按钮。如下图:




2.1.7 唱标

点击【唱标确认】进行唱标; 唱标结束后如下图:



2.1.7 异议与回复


投标人在开标阶段可以提出异议内容，投标人提出后，招标代理在右下角可以查看投标人提出的异议信息进行回复。如下图：

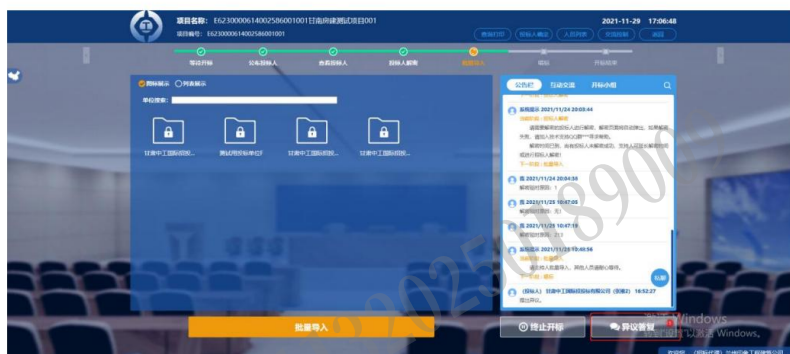

点击【异议答复】按钮查看异议；对异议进行回复后点击【回复异议】即可；



点击【已回复】可以切换到“已回复”菜单可查看回复的异议情况；

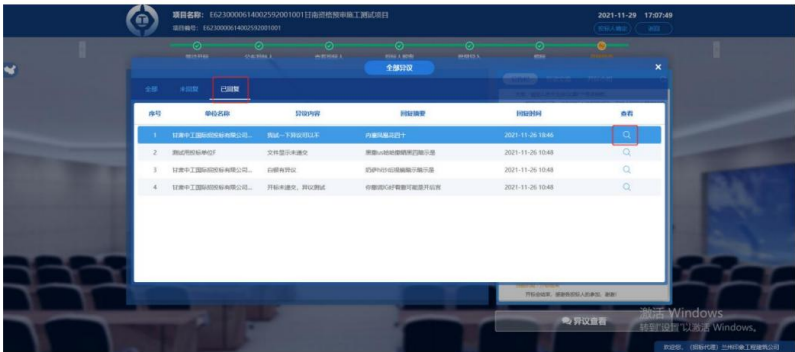

2.1.8 结束开标

点击开标结束，进行“开标结束”操作；




开标结束后可点击“开标记录表”进行查看。




2.2 投标人角色

2.1.1 登录

投标人打开开标大厅首页，点击【登录】，选择【招标代理】角色进行登录。登录方式可以选择账号密码直接登录也可选择CA登录。

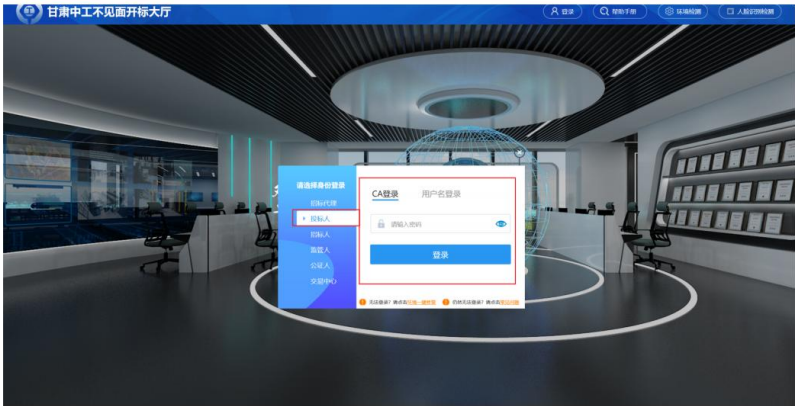


登录成功后进入开标项目页面。项目面板中【我的项目】会展示投标人参与的且今日开标的项目内容。也可打开历史项目查看历史项目。页面右上角会显示当前登录的投标人账号名称。

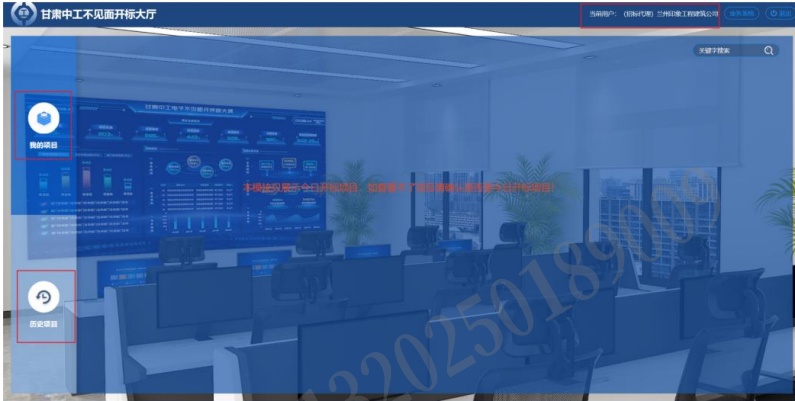

2.1.2 准备阶段

本阶段投标人需要在项目开标大厅中进行签到。

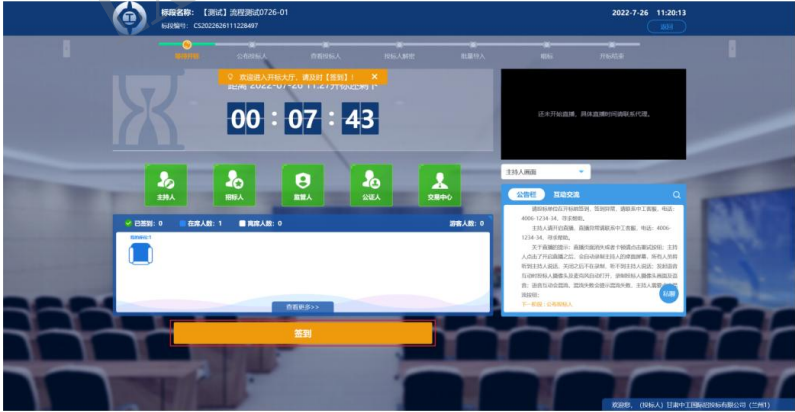


2.1.3 公布投标人

签到完成后，等待招标代理机构公布投标人，页面与招标代理页面同步，投标人观看等待即可。招标代理机构开启互动交流时，投标人可在互动交流中发言交流。




2.1.4 查看投标人

该模块可查看投标人情况，存在【图标显示】和【列表显示】。点击对应按钮即可查看对应方式的投标人陈列。

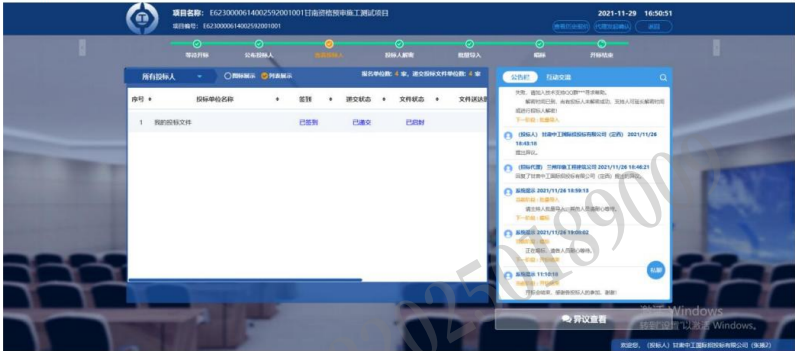

2.1.5 投标人解密

解密阶段：投标人页面自动显示投标解密内容，此阶段由投标人输入密码进行文件解密。如下图：

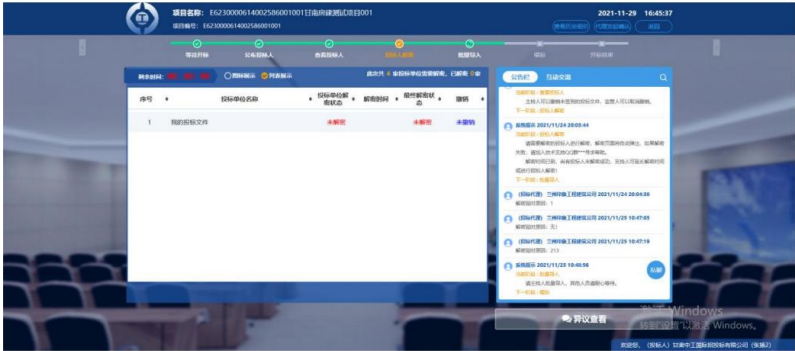

解密成功后如下图：



2.1.6 批量导入

解密完成后，由招标代理进行批量导入，投标人观看等待招标代理操作即可。

2.1.7 唱标

导入完成后，由招标代理开启唱标流程，投标人观看等待招标代理操作即可。

2.1.8 异议与回复

点击【开始异议文字提问】发起异议。



填写异议内容，点击【提交异议】进行提交。如下图：



异议提交后，代理机构会通过异议回复按钮进行回复，代理回复后，投标单位可通过【异议回复】按钮查看代理回复的信息内容。




2.1.9 结束开标

由招标代理结束开标，投标人观看等待招标代理操作即可。

2.3 招标人角色

2.3.1 登录

招标人打开开标大厅首页，点击【登录】，选择【招标代理】角色进行登录。登录方式可以选择账号密码直接登录也可选择CA登录。

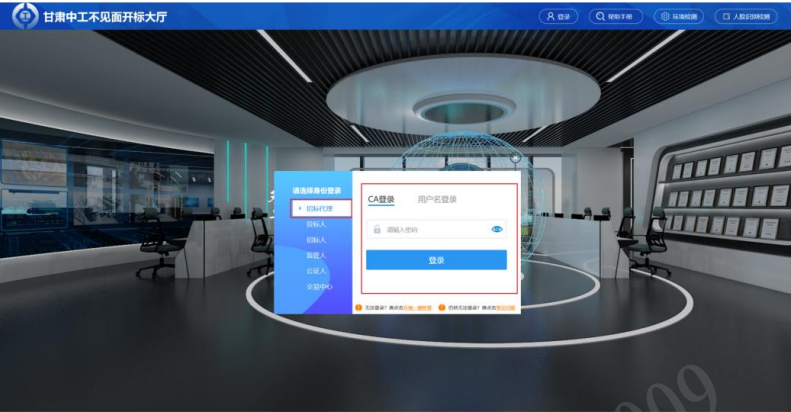


登录成功后进入开标项目页面。项目面板中【我的项目】会展示招标人所拥有的且今日开标的项目内容。也可打开历史项目查看历史项目。页面右上角会显示当前登录的招标人账号名称。

2.4 监管人角色

2.4.1 登录

监管人打开开标大厅首页，点击【登录】，选择【招标代理】角色进行登录。登录方式可以选择账号密码直接登录也可选择CA登录。

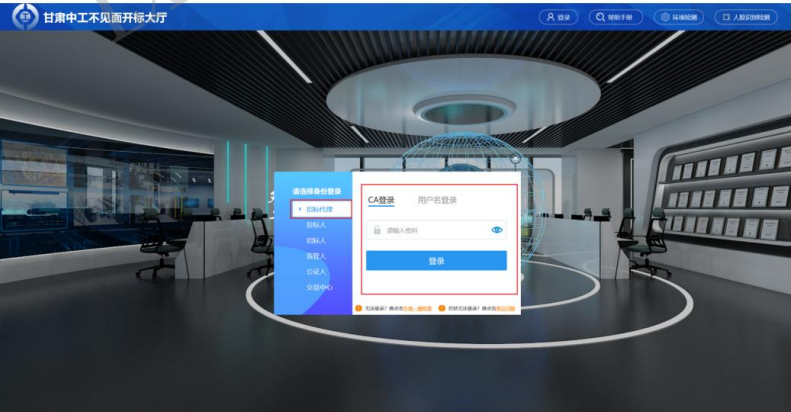


登录成功后进入开标项目页面。项目面板中【我的项目】会展示监管人所拥有的且今日开标的项目内容。也可打开历史项目查看历史项目。页面右上角会显示当前登录的监管账号名称。

2.5 公证人角色



2.5.1 登录

公证人打开开标大厅首页，点击【登录】，选择【招标代理】角色进行登录。登录方式可以选择账号密码直接登录也可选择CA登录。

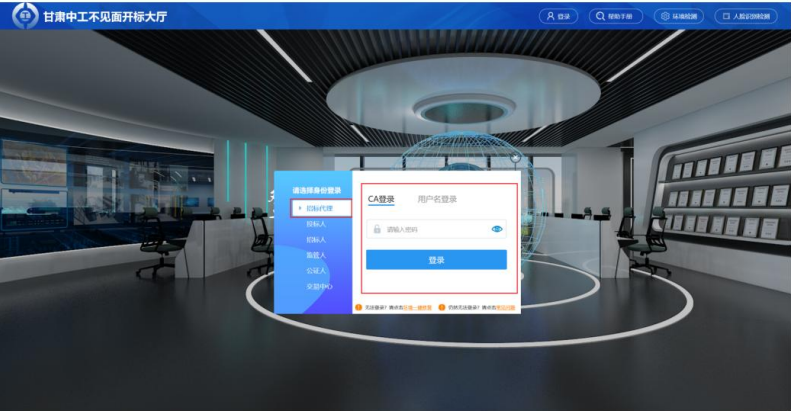


登录成功后进入开标项目页面。项目面板中【我的项目】会展示公证人所拥有的且今日开标的项目内容。也可打开历史项目查看历史项目。页面右上角会显示当前登录的公证人账号名称。

2.6 交易中心角色

2.6.1 登录

交易中心代表打开开标大厅首页，点击【登录】，选择【招标代理】角色进行登录。登录方式可以选择账号密码直接登录也可选择CA登录。

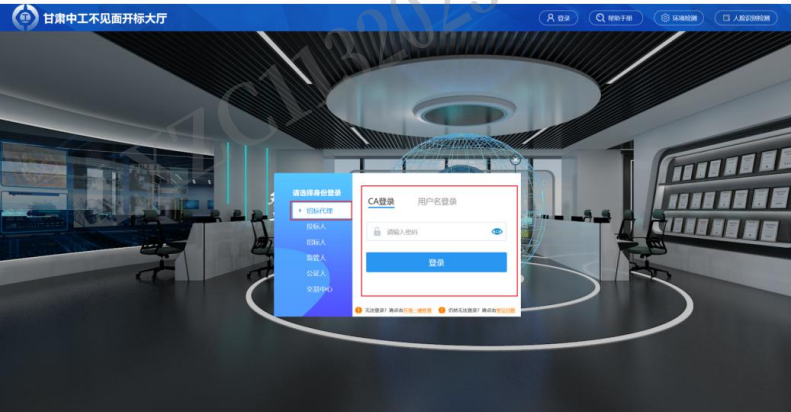

登录成功后进入开标项目页面。项目面板中【我的项目】会展示交易中心所拥有的且今日开标的项目内容。也可打开历史项目查看历史项目。页面右上角会显示当前登录的交易中心账号名称。

三、操作视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1VW4y117y8/>



环境配置说明文档

一、软件环境要求

- 操作系统：Windows7/8/10（推荐）
- 虚拟内存(RAM)：最低8G以上，推荐16G以上
- 基于 IE11的 IE 浏览器
- 电脑硬件：鼠标键盘，音响，麦克风（开标场景使用）正常运转。
- 正常联网环境。推荐使用有线连接，带宽100M以上。

二、环境配置操作

环境配置操作是为了使软件系统能正常运行在电脑上的安装及设置配置操作。所有的安装和设置都包含两个部分：相关系统和操作步骤，需求系统指需要进行配置方可正常使用的系统，使用者可参考操作步骤进行安装和配置。

2.1 投标工具软件安装

官网下载的投标工具软件为捆绑包，安装一个即拥有：投标标书制作软件、电子签章插件、标书查看工具以及相关驱动。若已安装同版本的其他工具如金格电子签章工具，在安装程序进行到对应软件时会先卸载后重新安装。

- 需求系统：招投标系统
- 操作步骤：
 - a. 打开 [甘肃中工官网](#)



- b. 使用者需要从【中工首页】-【下载中心】-【新版工具】找到“投标工具”进行下载



c. 安装



d. 勾选同意软件许可协议后即可进行快速安装，快速安装默认安装 C 盘。熟悉电脑的用户也可根据自身电脑情况进行自定义安装。



加载相关组件...



e. 点击快速安装后即开始安装，请耐心等待。



f. 当显示如上界面时表示安装已经完成。



2.2 IE浏览器设置


请使用IE11版本的IE浏览器。

2.2.1 受信站点添加与自定义级别设置


在初次使用系统时需要对系统的站点进行授信。

- 需求系统：电子服务平台（代理）、电子服务平台（监管）、不见面开标大厅、中工电子评标系统
- 操作步骤：
 - 受信站点添加


a. 打开浏览器。打开需要添加受信的系统页面。如：甘肃中工电子服务平台（代理）

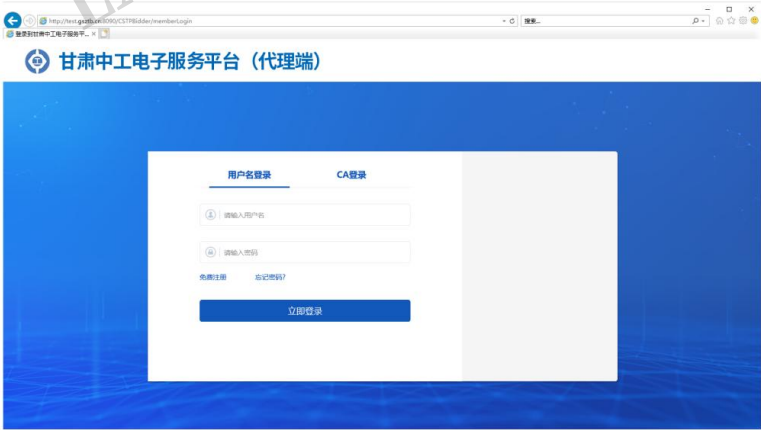


b. 选择【工具】-【Internet 选项】

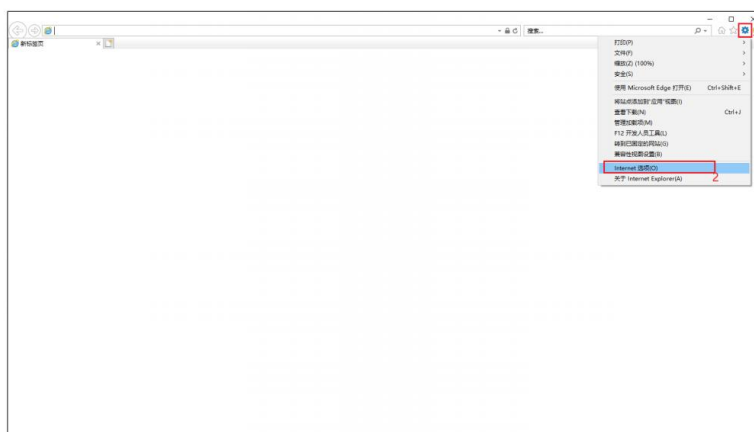

c. Internet选项界面，选项卡选择【安全】，点击下方【可信点】，选择【站点】。具体如下图：

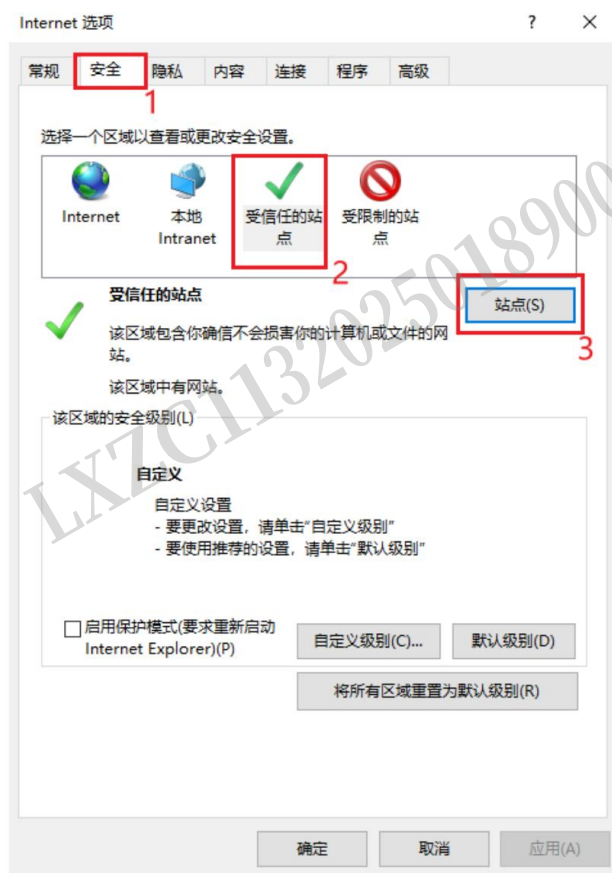

d. 当前网站会自动填充到区域点击【添加】后，网址会添加到下面的网站列表中。点击【关闭】退出受信任的站点界面

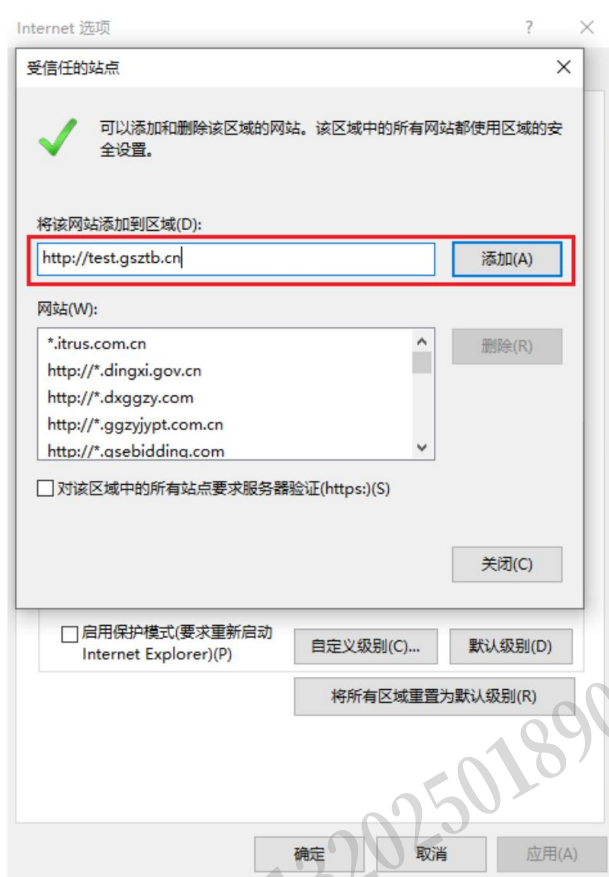



o 自定义级别设置


e. Internet选项界面 选项卡选择【安全】，点击下方【自定义级别】。具体如下图：



- f. 安全设置界面，建议将ActiveX控件和插件下属的所有内容按下图进行配置。全部点击【启用】可能会又部分安全隐患，不推荐。

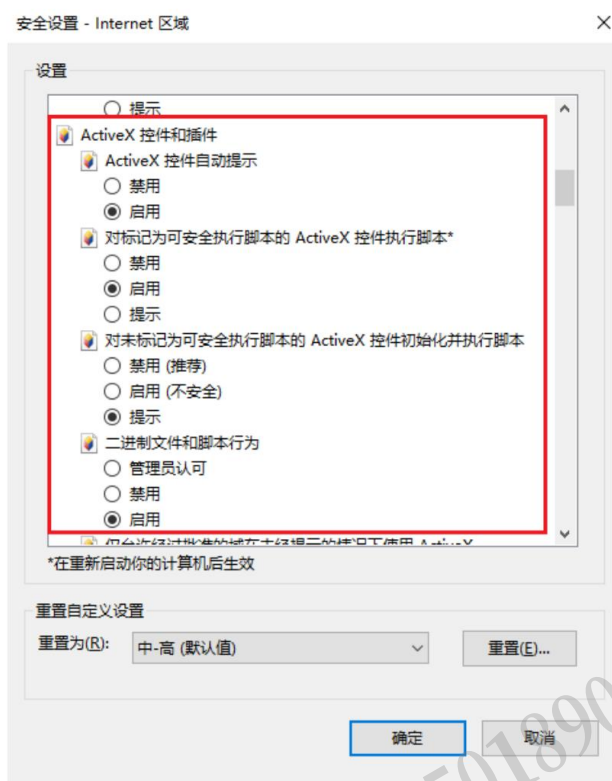

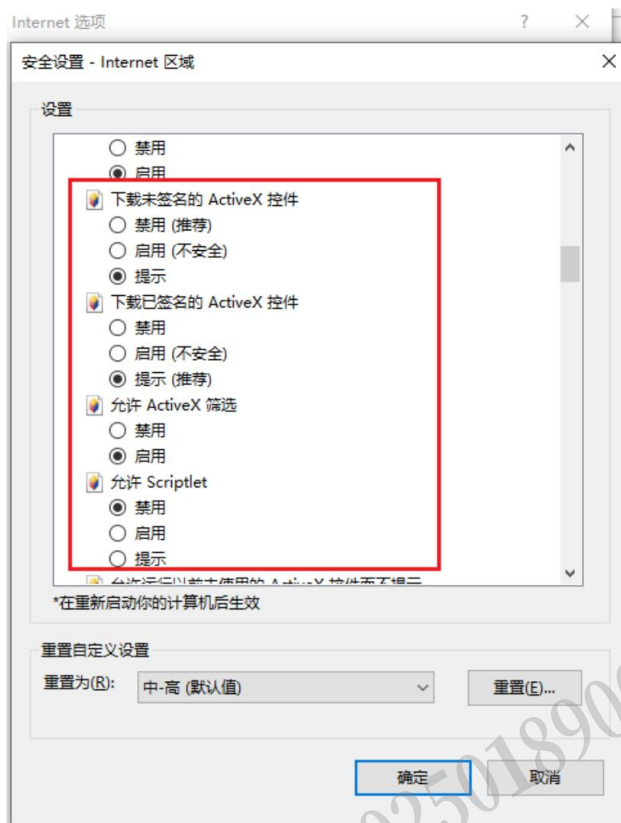

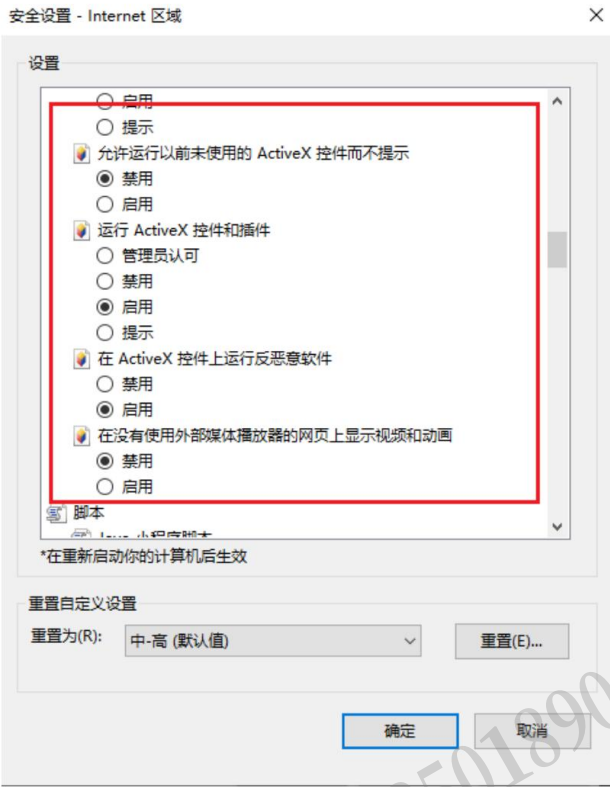

g. 安全设置界面，下载设置




h. 完成上述全部步骤后，点击【确认进行保存】


2.2.2 兼容性及拦截工具设置

在初次使用系统时需要对系统的站点进行兼容性视图添加。若系统无法正常使用时，可尝试拦截工具的关闭防止相关控件无法正常使用。


- 需求系统：电子服务平台（代理）、电子服务平台（监管）、不见面开标大厅、中工电子评标系统
- 操作步骤：
 - 兼容性设置
 - a. 打开浏览器。打开需要添加受信的的系统页面。如：甘肃中工电子服务平台（代理）
 - b. 点击【工具】－【兼容性视图】，如下图所示：

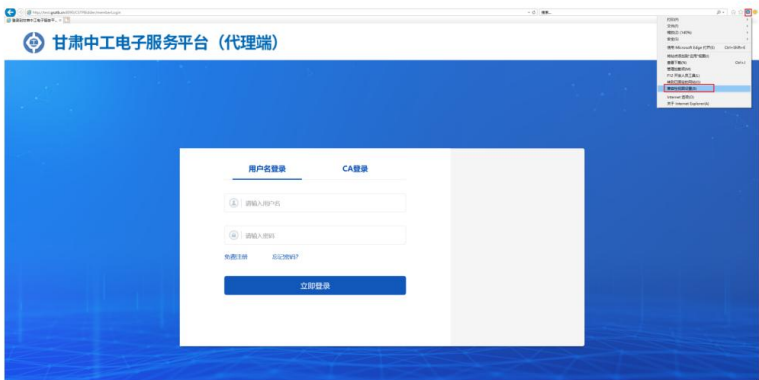

- c. 兼容性视图设置界面，当前网站会自动填充到区域，点击【添加】，添加后当前网站会自动进入已添加的兼容性视图的网站中。添加完成后点击【关闭】结束操作。

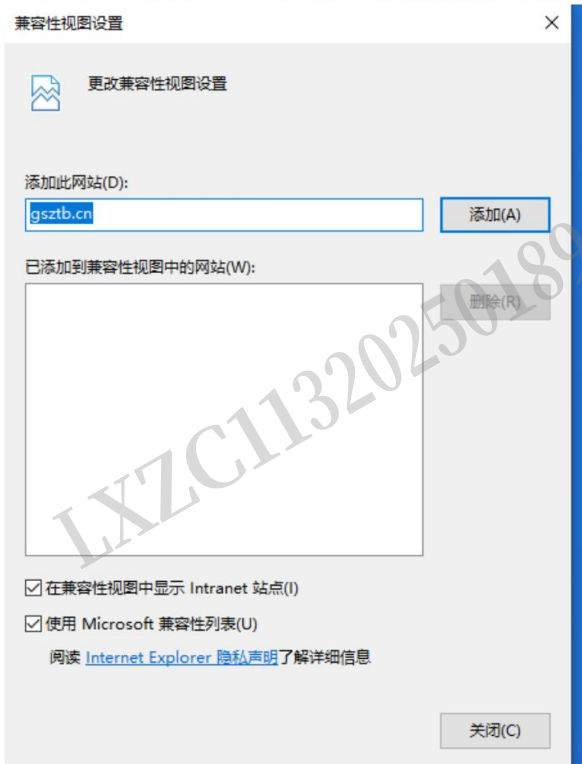


- o 拦截工具关闭
(注：此项操作作为上述操作结束后，浏览器依然无法正常启用系统中的某些功能时使用。)
- d. 老版IE，点击【工具】-【弹出窗口阻止程序】-【关闭弹出窗口阻止程序】，如下图所示：

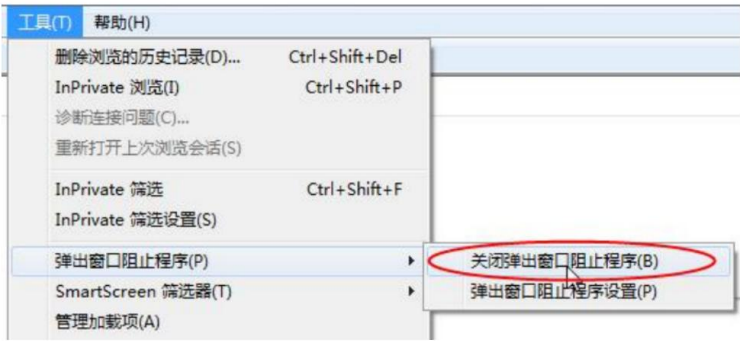

老版IE

e. IE11, 点击选择【工具】-【Internet 选项】-【隐私】 在弹出窗口阻止程序一栏取消勾选“启用弹出窗口阻止程序”。

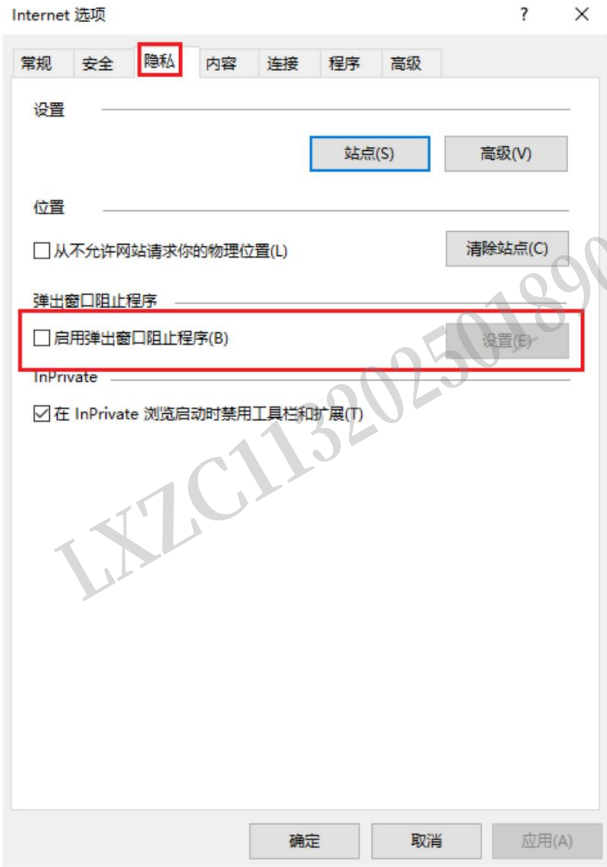

2.3 证书工具

证书工具是识别CA证书的电子软件，系统中任何需要电子认证、电子签章的行为都需要此工具已经安装。本节内容主要包括下载的操作步骤与证书工具功能的基本介绍。若使用者已根据本文 2.1投标工具软件 内容安装捆绑包，则无需再次安装证书工具。

- 需求系统：电子服务平台（代理）、电子服务平台（监管）、不见面开标大厅、中工电子评标系统



- 操作步骤：
 - 下载安装
 - i. 打开 [甘肃中工官网](#)
 - ii. 使用者需要从【中工首页】-【下载中心】-【新版工具】找到“甘肃互联互通版证书驱动”进行下载



- iii. 点击【快速安装】后即可进行快速安装，快速安装默认安装 C 盘。熟悉电脑的用户也可根据自身电脑情况进行【自定义安装】。



显示如下界面表示安装完成





- 功能介绍
 - 证书（内容陈列）

陈列电子证书的基本信息：证书所有者、序列号、证书类型、有效期、发证机构。
 - 检测

用于检测CA电子锁是否正常运行，通常检测系统、USB驱动、加密方式



- 设置
 - 设置功能主要用于修改CA锁使用时校验的PIN码。输入【旧密码】【新密码】和【确认的新密码】即可完成PIN码修改。



注：请不要忘记您的密码，如果忘记，请到该项目 CA 发证中心或联系系统管理员进行密码的初始化。


2.4 环境检测工具



检测工具是用来检测客户环境上是否成功的设置了可信任站点，是否安装了一些必要的控件，检测您的证书 Key 是否有效，检测您的证书 Key 能否成功盖章。用户可以点击桌面上的检测工具图标来启动检测工具。和证书工具同时安装，安装方法参考2.3中的下载安装内容。

- 需求系统：电子服务平台（代理）、电子服务平台（监管）、不见面开标大厅、中工电子评标系统
- 功能操作：

- i. 一键检测
点击【一键检测】开始检测

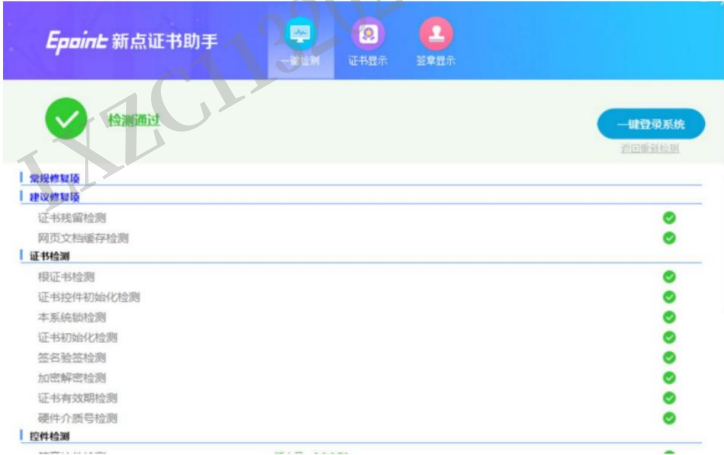


- 【证书检测】检测该证书 Key 是否可以正常使用。
- 【系统检测】该页面主要是进行可信任站点的设置。如果显示都是打钩，就证明已经设置成功。
- 【控件检测】如果以上都是打勾，系统所需要控件都安装完毕了。其中证书 Key 驱动。

- ii. 证书显示
用于检测证书状态。点击【证书显示】 - 选择对应证书类型即可陈列证书信息。
- iii. 签章检测



用于测试电子签章功能是否正常调用。点击【签章检测】系统会调用签章控件如下图所示：

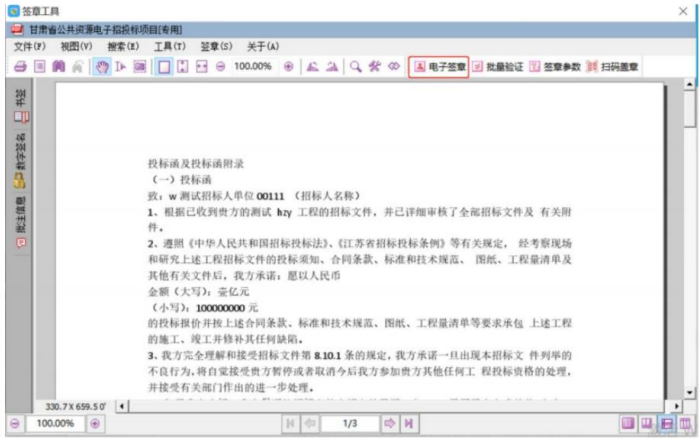


点击【电子签章】，选好签章位置后点击鼠标左键。输入电子章对应的PIN码后进行签章。若能正常签章则表明相关控件和驱动正常运行。若无法使用请先使用本工具【一键检测】功能进行检测后安装对应驱动或软件。若还是不行请联系中工客服。



2.5 直播工具

直播工具用于开标流程时，开标大厅的直播功能调用。

- 需求系统：不见面开标大厅
- 操作步骤：
 - a. 打开 [甘肃中工官网](#)
 - b. 使用者需要从【中工首页】- 【下载中心】- 【新版工具】找到“直播播放器”进行下载

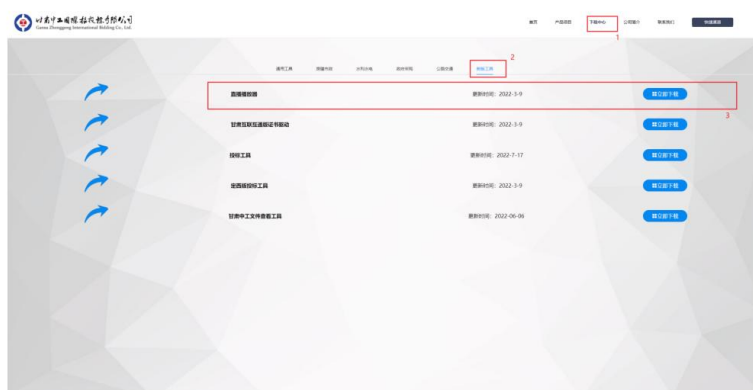

- c. 点击【快速安装】后即可进行快速安装，快速安装默认安装 C 盘。熟悉电脑的用户也可根据自身电脑情况进行【自定义安装】。




- d. 显示如下界面表示安装完成



2.6 文件查看工具

本工具用于查看招标文件、投标文件、控制价文件和答疑澄清文件这四种类型的文件。

- 需求系统：电子服务平台（代理）、电子服务平台（监管）、不见面开标大厅、中工电子评标系统
- 操作步骤：
 - a. 打开 [甘肃中工官网](#)
 - b. 使用者需要从【中工首页】- 【下载中心】 - 【新版工具】 找到“甘肃中工文件查看工具”进行下载。

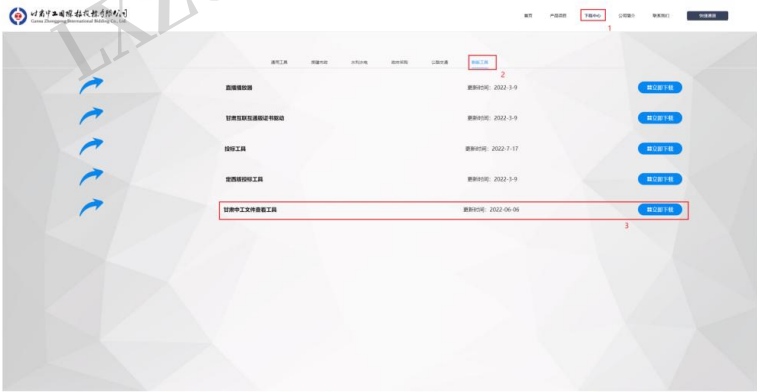

- c. 点击【快速安装】后即可进行快速安装，快速安装默认安装 C 盘。熟悉电脑的用户也可根据自身电脑情况进行【自定义安装】。



快速安装

☒ 我已阅读并同意 软件许可协议

[自定义安装>>](#)

d. 显示如下界面表示安装完成



完成

◦ 功能使用


分别点击四个不同类型的文件图标，即可打开对应类型的文件，选择需要的文件进行查看即可。




2.7 Edge浏览器的ie兼容模式设置

1. 打开Edge浏览器。

2. 点击右上角“...”图标菜单栏（也可按快捷键 ALT+F），选择【设置】

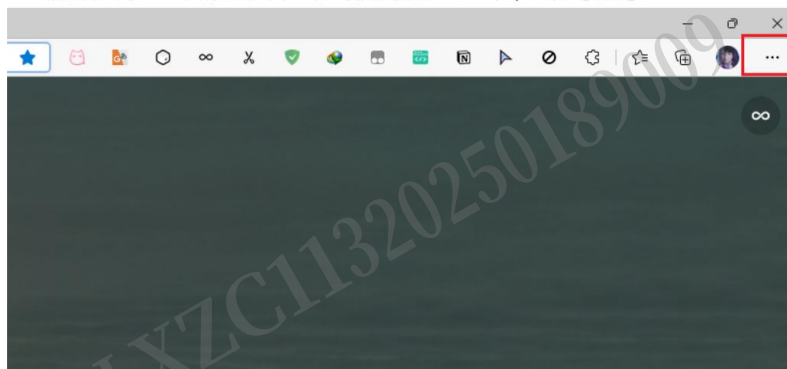

3. 选择【默认浏览器】，右侧找到“允许在 Internet Explorer 模式下重新加载网站 (IE 模式)”选择【允许】

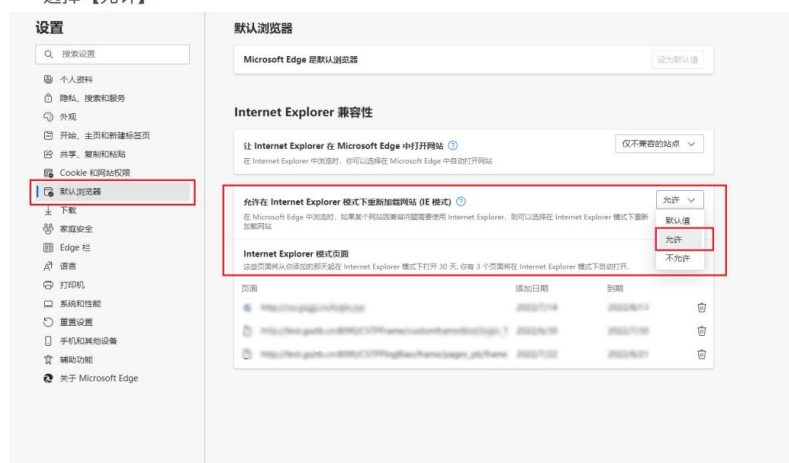



4. 重启浏览器，打开您需要使用的界面，点击右上角“...”图标菜单栏（也可按快捷键 ALT+F），选择【在 Internet Explorer 模式下重新加载】，就可以ie模式使用。

